

Lutte contre le coronavirus

Liens vers ressources et fichiers :

- <https://cloud.labsud.org/index.php/s/oW43ZQY366cAtXw?path=%2F>

- [Signaler sa disponibilité ou un besoin](#)
- [Masques](#)
 - [Informations scientifiques](#)
 - [Masque impression 3D](#)
 - [Masque couture](#)
 - [Tuto réalisation des masques tissus LABSud](#)
- [Gel hydroalcoolique](#)
 - [Recette](#)
 - [Distributeur](#)
- [Respirateur](#)
 - [Ressources](#)
- [Lunettes](#)
 - [Lunettes](#)
- [maintenance / i3d pièces rechange](#)
 - [valves de remplacement en i3d pour parer a l'urgence](#)
- [Ressources](#)
- [Visières](#)
 - [Visière LAHCEN](#)
 - [Liens / Inspirations](#)

- [LABSud V1 - Découpée laser - PETG 1mm](#)
 - [Visière LABSud MdWAM dit "B"](#)
 - [Visière LABSud MA dit "A"](#)
 - [Process de fabrication des visières et masques à LABSud](#)
 - [Mode d emploi pour monter la visiere Alpha](#)
-
- [Ecouvillon / Swab](#)
 - [Ouvre porte sans contact](#)
 - [Attache Masque](#)

Signaler sa disponibilité ou un besoin

Carte OSM (Impression/Matériel/Gel/Besoin)

Inscription sur le discord de Mr Bidouille nécessaire (voir ressources)

Carte de coordination géographique. Merci d'avance pour votre contribution :)

LIEN D'EDITION : <http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/anonymous-edit/432259:2s3fAtvnNDJYE20YhahuFeO57bM>

LIEN DE PARTAGE (lecture seul diffusable hors du discord) :
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/coordination-des-makers-vs-le-covid19_432259#13/43.6784/5.6868

OBJECTIF : repérer géographiquement les ressources à notre disposition. Merci de le remplir avec la nomenclature suivante :

- **Nom du Marqueur** : Votre_pseudo_discord #vos4chiffresid (+ description courte facultative) C'est pour pouvoir vous contacter via discord facilement.
- **Forme du Marqueur**
 - Rond Jaune : La position approximative de votre FABLAB, ou de votre ATELIER. Listez vos machines (Imp3D, matos électronique etc...)
 - Carré Rouge : La position approximative d'un stock/reserve de MATERIEL de maker (bobine PLA/ matos électronique) qui vous est accessible, et qui peut être mis à contribution. Listez le matos.
 - Carré Cyan : La position approximative de matériels/outils accessibles pour fabrication de GEL HYDRO en grande quantité. Listez le type de gel, la quantité envisageable et le délai de production si possible.
 - Carre Vert : La position approximative de matériels/outils accessibles pour fabrication de MASQUES. Listez le type de masque, la quantité envisageable, et le délai de production si possible.
 - Épingle Cyan : emplacement d'un besoin en GEL HYDRO, nombre de personne et profil (pour prioriser au besoin)
 - Épingle Vert : emplacement d'un besoin en MASQUE, nombre de personne et profil (pour prioriser au besoin)

---> La nomenclature pourra évoluer en fonction des besoins et des sollicitations (vérifier le discord)

Référencement des disponibilités en impression 3D par le fablab Descartes

Formulaire permettant de répertorier vos imprimantes, vos matériaux et vos disponibilités

<https://framaforms.org/inscription-reseau-dimprimeurs-3d-volontaires-1584449061>

Masques

Masques

Informations scientifiques

Normes


La résistance inspiratoire doit être inférieure à 0,7 mbar à 30 L/min et inférieure à 2,4 mbar à 95 L/min. La résistance expiratoire doit être inférieure à 3,0 mbar à 160 L/min.'

Respect de la norme : Norme OEKO-TEX pour le coton selon le CHU de Montpellier

The Homemade DIY Mask Test

Scientists from the University of Cambridge asked this exact question in the aftermath of the 2009 H1N1 flu pandemic. They thought that in a global pandemic scenario, we might run out of N95 masks. Their predictions have come true during the coronavirus outbreak.

The researchers asked volunteers to make their own masks using cotton t-shirts and a sewing machine using a simple protocol they'd devised. They then compared their effectiveness with surgical masks filtering particles as small as 0.65 microns.

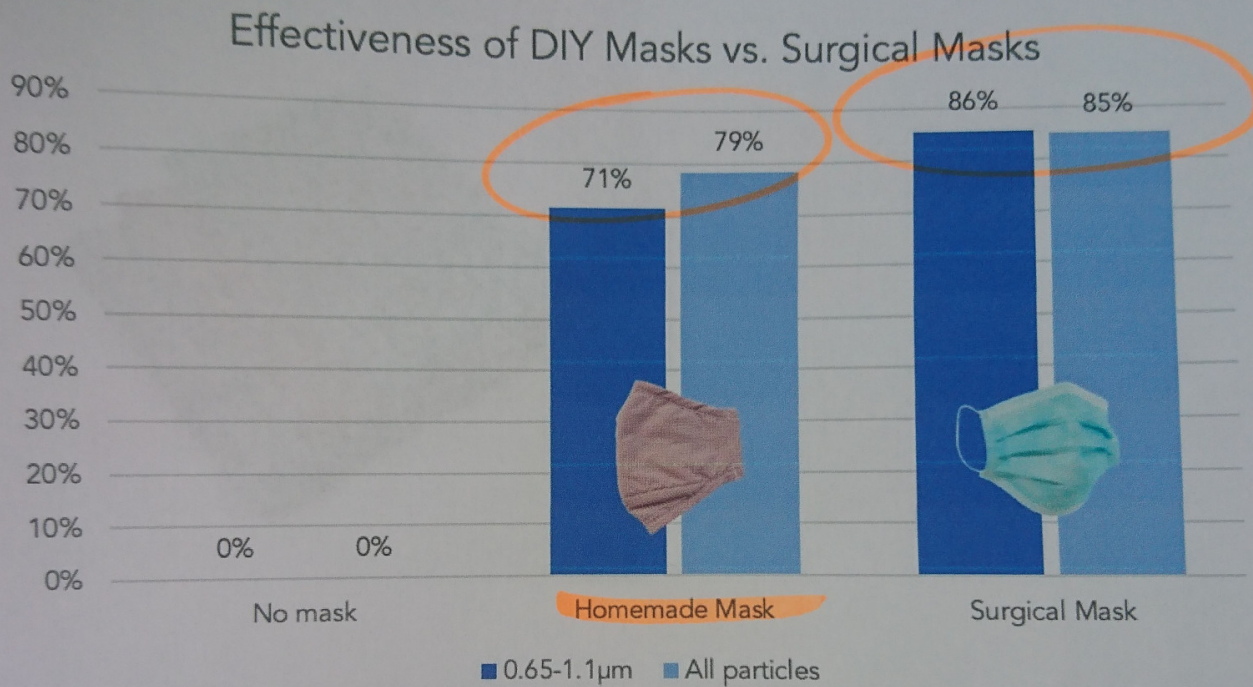

The homemade cotton masks captured 71% of 0.65-1.1 micron particles, compared with 86% for a surgical mask. Although the surgical masks captured 15% more particles, the cotton masks did surprisingly well. The researchers concluded that homemade masks would be better than nothing.

ABSTRACT

Objective: This study examined homemade masks as an alternative to commercial face masks.

Methods: Several household materials were evaluated for the capacity to block bacterial and viral aerosols. Twenty-one healthy volunteers made their own face masks from cotton t-shirts; the masks were then tested for fit. The number of microorganisms isolated from coughs of healthy volunteers wearing their homemade mask, a surgical mask, or no mask was compared using several air-sampling techniques.

Results: The median-fit factor of the homemade masks was one-half that of the surgical masks. Both masks significantly reduced the number of microorganisms expelled by volunteers, although the surgical mask was 3 times more effective in blocking transmission than the homemade mask.


Conclusion: Our findings suggest that a homemade mask should only be considered as a last resort to prevent droplet transmission from infected individuals, but it would be better than no protection.

(Disaster Med Public Health Preparedness. 2013;7-413-418)

Key Words: homemade facemasks, respirators, airborne transmission, microbial dispersion, pandemic prevention

https://www.rtbf.be/info/regions/brabant-wallon/detail_coronavirus-fabriquer-des-masques-pour-aider-ceux-qui-en-ont-besoin-d-accord-mais-pas-n-importe-comment?id=10459261&fbclid=IwAR3CXct4QYvUpL88-NfU7oY4w1w7ipf2wJVk8GbxD-wgF9hFkzqcHCvz34o

<https://sciencetonnante.wordpress.com/2020/03/12/epidemie-nuage-radioactif-et-distanciation-sociale/>

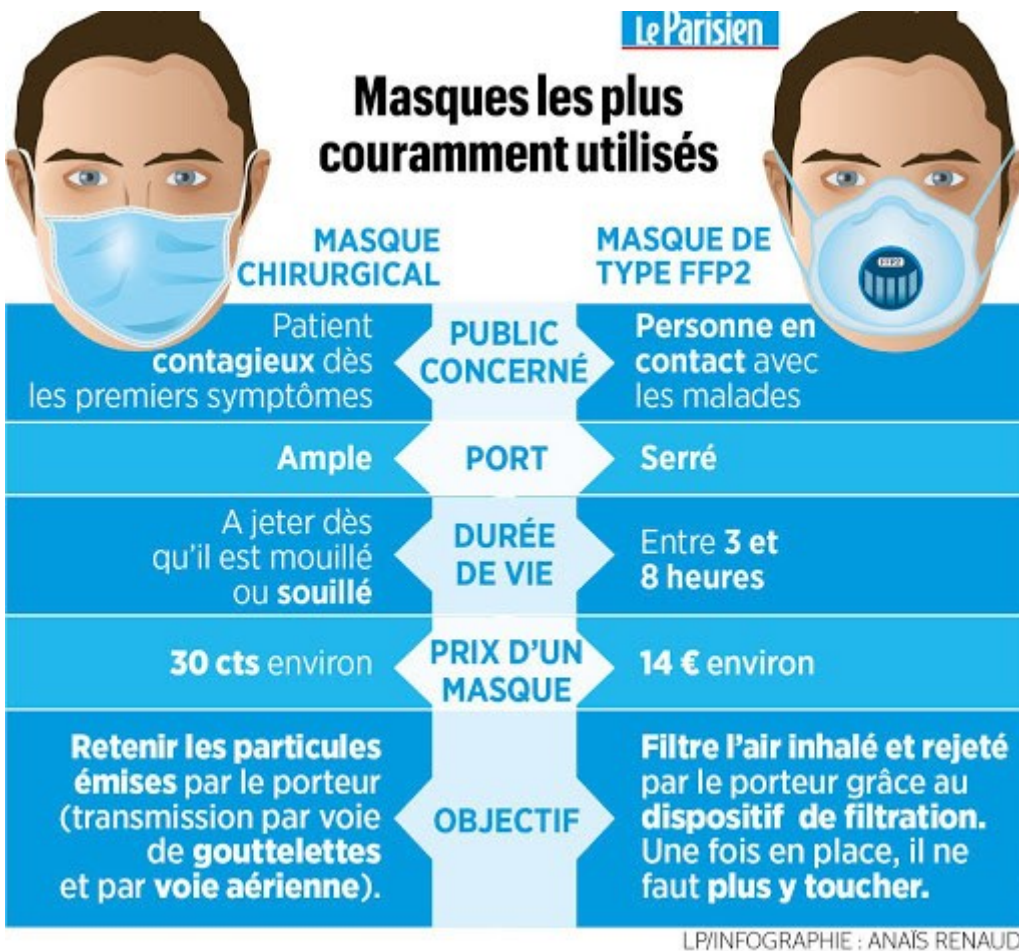

<https://smartairfilters.com/en/blog/best-materials-make-diy-face-mask-virus/>

https://www.researchgate.net/publication/258525804_Testing_the_Efficacy_of_Homemade_Masks_Would_They_Protect_in_an_Influenza_Pandemic

Précisions sur la réglementation relative aux DM

Les [masques chirurgicaux](#) sont des [DM](#) soumis à la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 transposée dans le code de la santé (CSP) et différents arrêtés puis, **à compter du 26 mai 2020**, au [règlement \(UE\) 2017/745](#) (renforçant un certain nombre d'exigences).

La réglementation définit **4 classes** de DM : I, IIa, IIb et III, liées au niveau de risque potentiel pour le patient, le personnel soignant ou toute autre personne intervenant lors de l'utilisation. La classe I est la classe de risque la plus faible et regroupe la majorité des DM non invasifs dont font partie les masques chirurgicaux, les gants d'examen et certains types de blouse.

En vue de leur mise sur le marché, les DM doivent être revêtus du **marquage CE**, attestant de leurs performances et du respect de la procédure d'évaluation de la conformité aux **exigences essentielles de sécurité et de santé** énoncées par le CSP (articles [R.5211-21 à R.5211-24](#)) et l'article 1^{er} de l'[arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions de mise en œuvre des exigences essentielles applicables aux DM](#) (l'annexe I du règlement (UE) 2017/745 fixe les exigences générales équivalentes en matière de sécurité et de performances). L'article [R.5211-18](#) du CSP établit une **présomption de conformité aux exigences essentielles pour les DM qui satisfont aux normes harmonisées publiées au Journal officiel de l'Union européenne**.

Pour les DM de classe I que sont les masques chirurgicaux, gants d'examen et certains types de blouse, la procédure d'évaluation de la conformité applicable (déclaration CE de conformité) ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié. Elle induit notamment, pour le fabricant, d'établir la documentation technique décrite au point 3 de l'article 1^{er} de l'[arrêté du 15 mars 2010 fixant les modalités d'application des procédures de certification de la conformité](#). **Spécifiquement pour les masques chirurgicaux, il existe une norme harmonisée portant sur leur fabrication et leur conception : la norme EN 14683:2005 (exigences et méthodes d'essai). Le respect de cette norme permet de répondre aux exigences en matière d'infection et de contamination microbienne.** Vous trouverez cette norme en pièce jointe (version mise à jour en mars 2019).

[Recommandation de la Commission visant à assouplir les procédures d'évaluation de la conformité et de surveillance du marché des EPI et DM dans le contexte de la menace que représente le COVID-19](#)

La Commission a publié le 16 mars une recommandation référencée (UE) 2020/403 dans laquelle elle invite l'ensemble des opérateurs économiques ainsi que les organismes notifiés et les autorités de surveillance du marché à **mettre en œuvre toutes les mesures à leur disposition pour soutenir les efforts visant à faire en sorte que l'offre d'EPI et de DM sur le marché de l'UE dans son intégralité réponde à la demande en constante augmentation**. Elle suggère notamment, lorsque les autorités de surveillance du marché constatent que des EPI ou des DM garantissent un niveau adéquat de santé et de sécurité conformément aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/425 ou de la directive 93/42/CEE ou du règlement (UE) 2017/745, **même lorsque les procédures d'évaluation de la conformité, y compris l'apposition du marquage CE n'ont pas été menées à leur terme dans le respect des règles harmonisées, d'autoriser la mise à disposition de ces produits sur le marché de l'Union pendant une période limitée et pendant que les procédures nécessaires sont effectuées**.


Ces éléments peuvent être communiqués au professionnel en parallèle de la redirection vers l'ARS locale. Ils vont être intégrés dans la FAQ interne disponible dans l'[espace GECl dédié au COVID-19](#).

Enfin, la direction générale de la santé (MSS) prépare une communication sur la mobilisation des capacités de production pour la fabrication de masques (des échanges sont en cours avec la filière textile). Elle devrait être diffusée sous 48 heures (d'ici le 20 mars).

Masques

Masque impression 3D


COVID-19 Emergency DIY mask

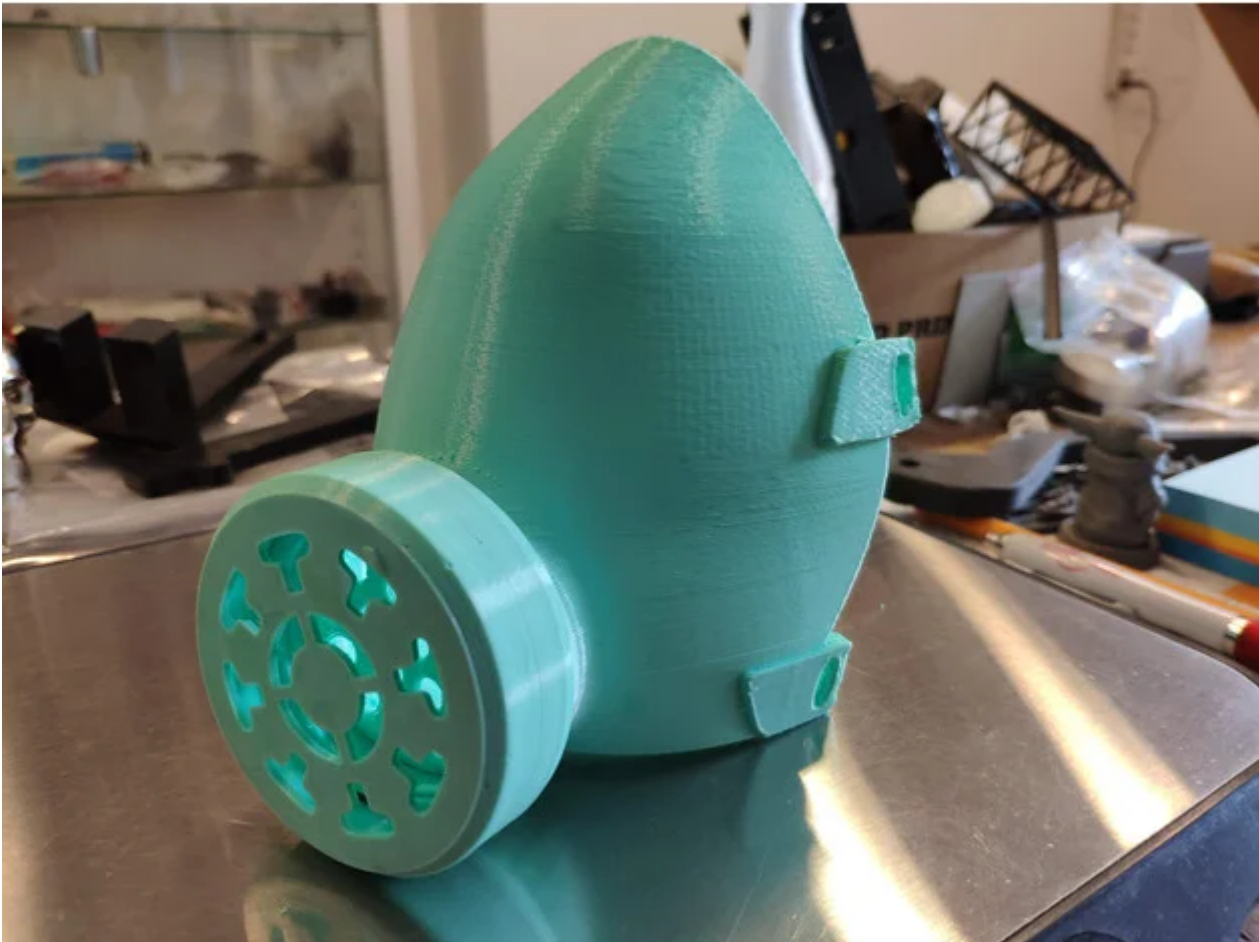

https://www.thingiverse.com/thing:4215454?fbclid=IwAR35AOcp27AKN3NOsNFg_Ge9_FK5xHRP77zBgF6wh_BsjZCI-AHcoYnt64k

TPU : 0.1mm, 20% = 17:57 d'impression, 114g // 0.2mm, 20% = 8:58 d'impression, 112g

HEPA Covid Coronavirus Face Mask

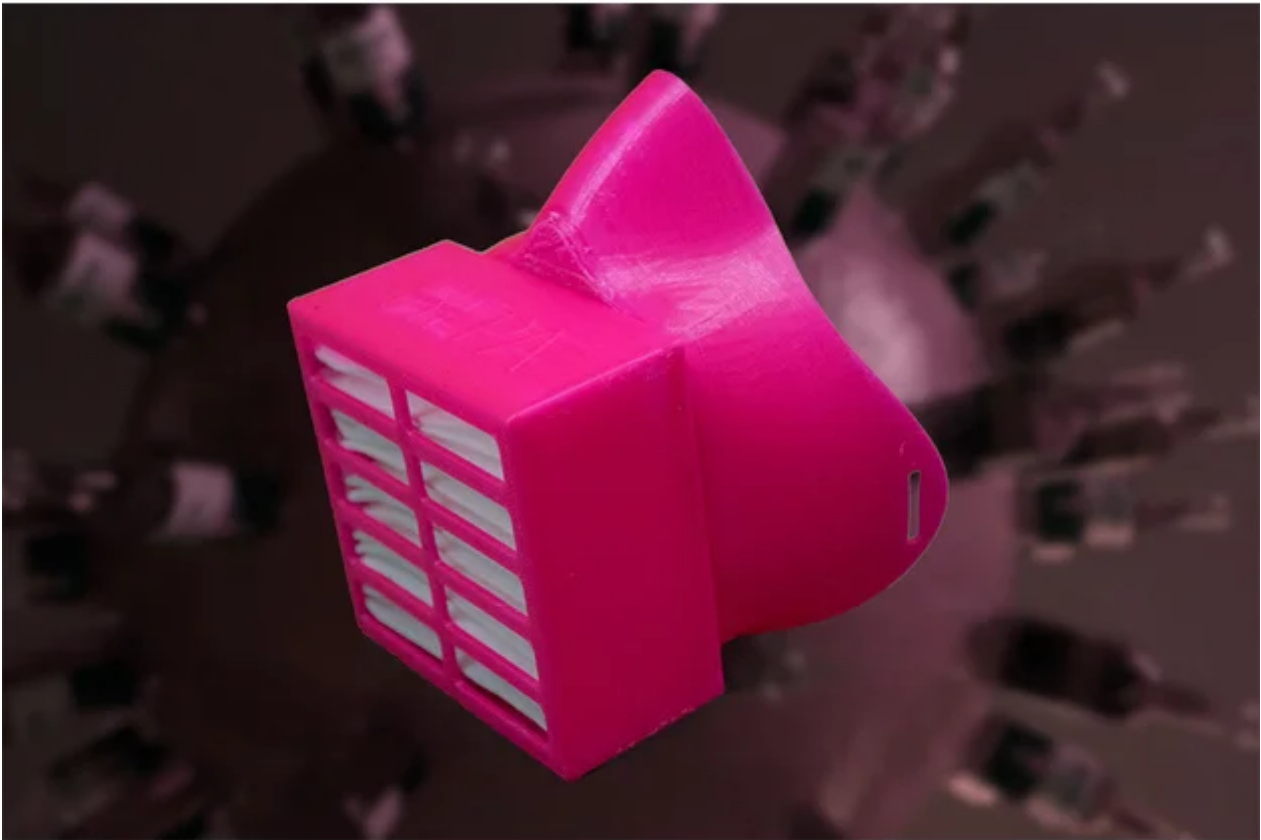

<https://www.thingiverse.com/thing:4222563?fbclid=IwAR1WrvAMgD0hk2ffZbTDmoshRHy0kyJbNWHa1g5iyVVwjfeopPuf8bHxsLk>

TPU : 0.2mm, 20% = 12:13 d'impression, 77g pour le modèle "update-4_HEPA-filter_male_12cm"

Personal Antimicrobial Facemask



https://www.thingiverse.com/thing:4214066?fbclid=IwAR302HbYV1nHJaitok1xFeBOToeEZsD_8Fp9zBj5mN607c17YHRAmry46k

TPU : 0.2mm, 20% = 4:05 d'impression, 20g

Simply Flexible Mask Valvy



https://www.thingiverse.com/thing:4185367?fbclid=IwAR1C-fxkGiT2FqXlZkmRf3ZhVWFkZ5l_enZVEAY1v1jCpI3BnOGdCyDaG30

TPU :

Flexible Mask Valvy [PLA too]



https://www.thingiverse.com/thing:4177128?fbclid=IwAR16ZhaUkRLr2fYOMLYD6mQxRrVZwKuRM4fk2gLpBKKSJb_PHnvvjag-B_Q

TPU : 0.2mm, 20% = environ 17:00 d'impression vu le nombre de pièce et environ 95g

MASK COVI 19 REMIX NanoHack by Boutiprint



<https://copper3d.com/hackthepandemic/>

<https://www.thingiverse.com/thing:4230330/files>

Masques

Masque couture

- Masque de protections 5 à 7 couches de [polypropylène](#) non tissé 30g/m²
- Expérimentation en cours pour le thermocollage (à privilégier)
- Liens à découper avec l'enveloppe (éviter les liens cousus)

Masques en deux parties – Enveloppe rectangulaire – 36x19cm

La partie filtre – superposition de 3-5 couches de PP 15cm x15cm

Liens à inclure dans le rectangle enveloppe à 2cm.

Composition du filtre: pp non-tissé, coton, molleton de coton, microfibres (attente avis du CHU : Mercredi 18 mars après midi)

Découpe laser possible : (Plusieurs couches testé par Anne/Mentzo) mais risques de thermocollage entre les couches

Matériels nécessaires

1. Rouleaux de tissus cotons (Norme OEKOTEX : <https://www.plim.fr/fr/content/29-info-oekotex>)
2. Voiles d'hivernages (<https://jardinage.ooreka.fr/comprendre/voile-d-hivernage>) (attente du bon de commande 160m² disponible à castries soit 300 masques)
3. Machines de thermocollage en points / lignes (Il faudrait une machine pour du thermocollage par point (lanières), une autre pour des lignes droites. Tout le masque doit être plié puis cousu ou thermocollé sur 3 côtés)
4. Élastiques (Diamètre entre 2 à 5mm, 2x18cm par masques (à la place des lanières))

Personnels nécessaires

1. Couturières

Tests

[Masque_Test.jpg](#)

[Masque_Test2.JPG](#)

[image-1584531459258.png](#)

Spécifications

- lavable à 90°
- filtration mieux que rien
- réutilisables
- bonne résistance structurelle.
- Thermocollable.

Élastiques

Diamètre entre 2 à 5mm, 2x18cm par masques (à la place des lanières)
40cm par masque.

Lanières

Carrés 15x15 entre les 2 lanières; ça en fait 6. Ensuite faudra agencer un deuxième, en le retournant, dessous.

Plis

Inclure 13cm de fil de cuivre, idéalement du 1.5mm² dénudé pour épouser le nez.
4 plis de 2cm (pliage du masque avant couture ou thermocollage) voir photo 1

Thermocollage

- * des points ronds (diamètre: 10mm)
- * Température entre 100 et 180°
- * Durée et pression à définir

Rouleau

- 2 mètres de largeur / : 5 masques en largeur
- 5/10 mètres de longueur
- Système de pré découpe type fleuriste nécessaire

Couturières

- GooglesForm pour recensement et contact :

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMrxeH3rNUqC8Vhun45ogoxhdcOIDKdqAjF6O>

[bONQOUCOBUg/viewform?usp=pp_url](https://www.facebook.com/groups/1120744844933688/)

(Lien ajouter dans le tuto de réalisation des masques par LABSud)

Ressources

- <https://www.facebook.com/groups/1120744844933688/>
- https://www.rtb.be/info/regions/brabant-wallon/detail_coronavirus-fabriquer-des-masques-pour-aider-ceux-qui-en-ont-besoin-d-accord-mais-pas-n-importe-comment?id=10459261&fbclid=IwAR3CXct4QYvUpL88-NfU7oY4w1w7ipf2wJVK8GbxD-wgF9hFkzqcHCvz34o

(Lien ajouter dans le tuto de réalisation des masques par LABSud)

Réglementation

Précisions sur la réglementation relative aux DM

Les [masques chirurgicaux](#) sont des [DM](#) soumis à la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 transposée dans le code de la santé (CSP) et différents arrêtés puis, **à compter du 26 mai 2020**, au [règlement \(UE\) 2017/745](#) (renforçant un certain nombre d'exigences).

La réglementation définit **4 classes** de DM : I, IIa, IIb et III, liées au niveau de risque potentiel pour le patient, le personnel soignant ou toute autre personne intervenant lors de l'utilisation. La classe I est la classe de risque la plus faible et regroupe la majorité des DM non invasifs dont font partie les masques chirurgicaux, les gants d'examen et certains types de blouse.

En vue de leur mise sur le marché, les DM doivent être revêtus du **marquage CE**, attestant de leurs performances et du respect de la procédure d'évaluation de la conformité aux **exigences essentielles de sécurité et de santé** énoncées par le CSP (articles [R.5211-21 à R.5211-24](#)) et l'article 1^{er} de l'[arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions de mise en œuvre des exigences essentielles applicables aux DM](#) (l'annexe I du règlement (UE) 2017/745 fixe les exigences générales équivalentes en matière de sécurité et de performances). L'article [R.5211-18](#) du CSP établit une **présomption de conformité aux exigences essentielles pour les DM qui**

satisfont aux normes harmonisées publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Pour les DM de classe I que sont les masques chirurgicaux, gants d'examen et certains types de blouse, la procédure d'évaluation de la conformité applicable (déclaration CE de conformité) ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié. Elle induit notamment, pour le fabricant, d'établir la documentation technique décrite au point 3 de l'article 1^{er} de l'[arrêté du 15 mars 2010 fixant les modalités d'application des procédures de certification de la conformité](#).

Spécifiquement pour les masques chirurgicaux, il existe une norme harmonisée portant sur leur fabrication et leur conception : la norme EN 14683:2005 (exigences et méthodes d'essai). Le respect de cette norme permet de répondre aux exigences en matière d'infection et de contamination microbienne. Vous trouverez cette norme en pièce jointe (version mise à jour en mars 2019).

Recommandation de la Commission visant à assouplir les procédures d'évaluation de la conformité et de surveillance du marché des EPI et DM dans le contexte de la menace que représente le COVID-19

La Commission a publié le 16 mars une recommandation référencée (UE) 2020/403 dans laquelle elle invite l'ensemble des opérateurs économiques ainsi que les organismes notifiés et les autorités de surveillance du marché à **mettre en œuvre toutes les mesures à leur disposition pour soutenir les efforts visant à faire en sorte que l'offre d'EPI et de DM sur le marché de l'UE dans son intégralité réponde à la demande en constante augmentation**. Elle suggère notamment, lorsque les autorités de surveillance du marché constatent que des EPI ou des DM garantissent un niveau adéquat de santé et de sécurité conformément aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/425 ou de la directive 93/42/CEE ou du règlement (UE) 2017/745, **même lorsque les procédures d'évaluation de la conformité, y compris l'apposition du marquage CE n'ont pas été menées à leur terme dans le respect des règles harmonisées, d'autoriser la mise à disposition de ces produits sur le marché de l'Union pendant une période limitée et pendant que les procédures nécessaires sont effectuées**.

Ces éléments peuvent être communiqués au professionnel en parallèle de la redirection vers l'ARS locale. Ils vont être intégrés dans la FAQ interne disponible dans l'[espace GECl dédié au COVID-19](#).

Enfin, la direction générale de la santé (MSS) prépare une communication sur la mobilisation des capacités de production pour la fabrication de masques (des échanges sont en cours avec la filière textile). Elle devrait être diffusée sous 48 heures (d'ici le 20 mars).

(Texte ajouté dans Masques/ Informations scientifiques)

Masques

Tuto réalisation des masques tissus LABSud

Recommandation AFNOR : 60g/m²

Prototype envoyé a la DGA (Direction Général de l'Armement).

Au 15/04/2020, ils ont reçu 1.500 demande d'avis sur les masques, alors on risque d'attendre avant d'avoir un retour...

Matériels nécessaires

1. Rouleau de [polypropylène](#) non tissé 30g/m² type "voiles d'hivernages"
 1. 100cm de largeur et 5/10 mètres de longueur
2. rubans, lacets, fils élastiques ou gros fils pour les attaches

Machines nécessaires

1. Machine à coudre avec fils
2. Découpe laser

Couturières

- GooglesForm pour recensement et contact :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMrxeH3rNUqC8Vhun45ogoxhdcOIDKdqAjF6ObONQOUCOBUg/viewform?usp=pp_url


-

Spécifications

- **Stérilisable thermique** : Étuve/Autoclave : 135°C pendant 20 min
- Lavage plus compliqué : apparition de bouloches donc moins agréable
- Réutilisable
- Bonne résistance structurelle

Fabrication

1. Positionner 2 à 6 (attente retour DGA) couches de polypropylène les une par dessus les autres.
2. Faire des traits sur la longueur comme indiqué sur le patron :

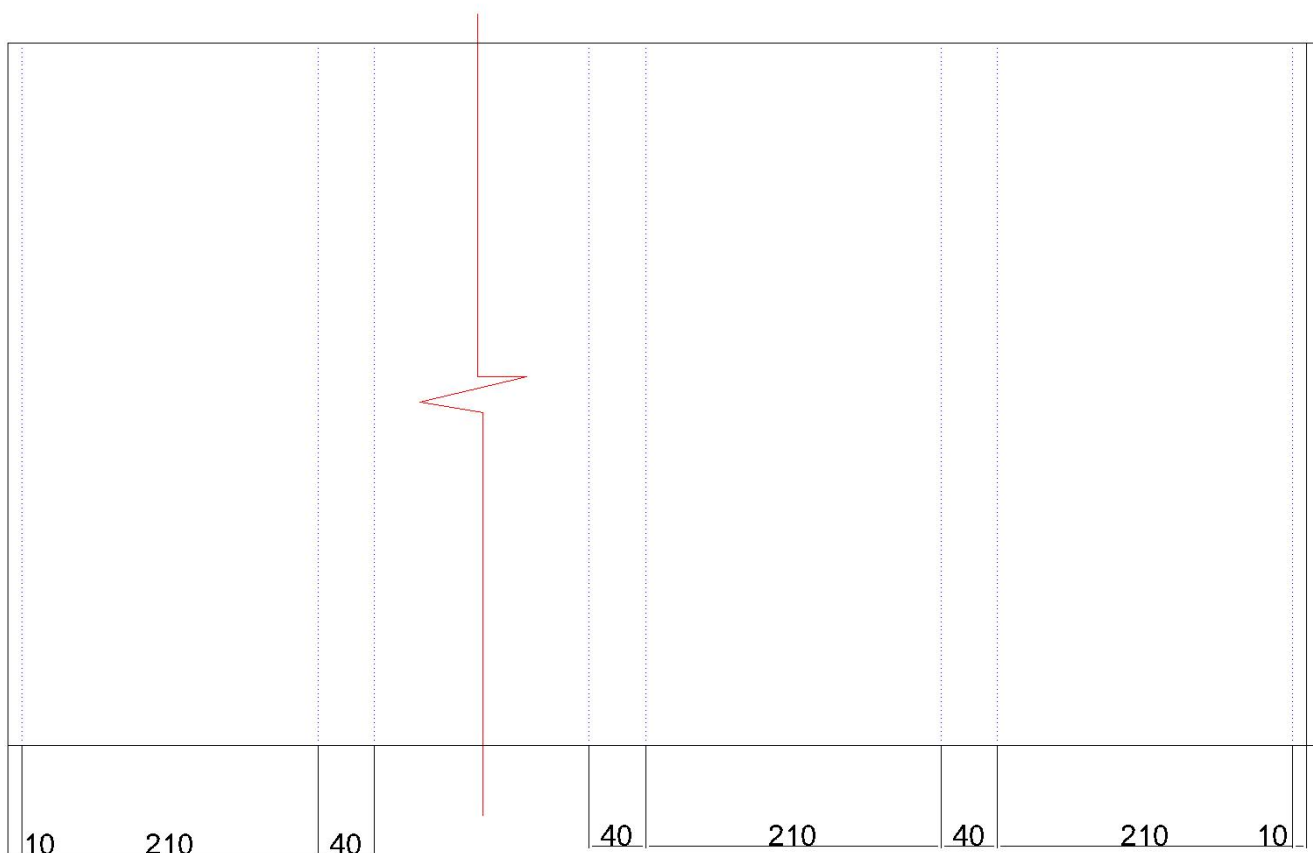

(21 cm puis 4 cm puis 21 etc...) ce qui permet de faire 3 masques (si on prend 50 cm de large) tous les 25 cm (soit $3 \times 4 = 12$ masques/mètre)

3. Coudre en ligne droite sur ces traits (attention le tissu étant léger il a tendance à se tordre et glisser : il est conseillé de s'aider d'épingles pour tenir le tissu en place)
4. Poser le rouleau ainsi cousu dans la laser
5. Envoyer le fichier dans le logiciel de la laser (soit "**MASQUE TISSUS LABSUD.dxf**" ou pour Laserwork "**MASQUE TISSUS LABSUD.rld**" à télécharger dans le cloud) en veillant bien à ce que le tissu soit tendu et les lignes cousues bien

horizontales (Paramètres : vitesse = 100 mm/s et puissance = 60% /! attention : ces paramètres sont donnés à titre indicatif faire un test selon la puissance de la machine !/)

6. Sortir les masques une fois découpés
7. Insérer les rubans, lacets, fils ou autres systèmes d'attaches dans les trous en "zigzag" (photo à venir)

Note : Dans le cadre de la production de ses masques à LABSud, les masques sont conditionnés par paquet de 50 (à confirmer) dans un sac refermable et les attaches ne sont pas fournies.

Liens et Ressources :

[Liens vers le dossier cloud où se trouve les fichiers de découpe](#)

[Lien vers vidéos de marquage "20200408_095855.mp4" et "20200408_100121.mp4"](#) et lien Youtube à venir

[Lien vers vidéo de couture "20200408_101055.mp4"](#) et lien Youtube à venir

- <https://www.facebook.com/groups/1120744844933688/>
- https://www.rtbef.be/info/regions/brabant-wallon/detail_coronavirus-fabriquer-des-masques-pour-aider-ceux-qui-en-ont-besoin-d-accord-mais-pas-n-importe-comment?id=10459261&fbclid=IwAR3CXct4QYvUpL88-NfU7oY4w1w7ipf2wJVk8GbxD-wgF9hFkzqcHCvz34o

Gel hydroalcoolique

Gel hydroalcoolique

Recette

Officielle (OMS)

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/guide_production_locale_produit_hydro_alcoolique.pdf?ua=1

(pdf joint à la documentation au cas où)

Alternatives

<https://planetezerodechet.fr/coronavirus-recette-gel-hydroalcoolique-lotion-antibacterien-mains/>

Gel hydroalcoolique

Distributeur

<https://www.facebook.com/biomakersb/videos/vb.854491824760411/196025641848175/?type=2&theater>

Respirateur

Respirateur

Ressources

https://blog.arduino.cc/2020/03/17/designing-a-low-cost-open-source-ventilator-with-arduino/?fbclid=IwAR1t7_rcz4-VLQzwVGPCUhNSiEMfD1PYkuf5gvDb1U-2cyKKYirJwGIHbJI

https://www.3dnatives.com/impression-3d-covid-19-16032020/?fbclid=IwAR1gY4E4mxNgVZc0H7c_h0mGRll2h9TOwYuhpjAyuLZTh1LGTa_cwqgsbol

<https://www.facebook.com/groups/670932227050506/permalink/676860193124376/>

<https://grabcad.com/library/respirator-free-reanimation-venturi-s-valve-1?fbclid=IwAR3jzbb65te7gWifQrfjc11ajseWI0PWdjulxyV5hbdjXdbyPxOtcGCe0RE>

<https://www.gov.uk/government/publications/specification-for-ventilators-to-be-used-in-uk-hospitals-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak?fbclid=IwAR2-vnJsQ0OZnjcWnM0J1MJlYUsKXQ7062rUunzbMNItDDLjQpCGtzxRiyA>

Lunettes

Lunettes

Lunettes

<https://www.3dnatives.com/bouclier-facial-imprime-en-3d-prusa-200320203/>

<https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3052135/polytechnic-university-lab-3d-printing->

[face?fbclid=IwAR1jDHyhf8y274iY4YyDaLYvuL207iYm4gNaAEt3n0oHSJN2Qdp8NEHQMSI](https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3052135/polytechnic-university-lab-3d-printing-face?fbclid=IwAR1jDHyhf8y274iY4YyDaLYvuL207iYm4gNaAEt3n0oHSJN2Qdp8NEHQMSI)

<https://www.prusaprinters.org/prints/25714-pomoznemocnicisk-protective-shield/files>

<https://making.engr.wisc.edu/shield/>

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4228863213805867&id=118007634891466

maintenance / i3d pièces
rechange

maintenance / i3d pièces rechange

valves de remplacement en i3d pour parer a l'urgence

pièces de rechange imprimées en 3d pour parer a l'urgence en attendant la dispo fournisseur :
questions: porosité ? materiau ? a voir au cas par cas, mais les fablabs ont été sollicités en italie
pour cela: cf <http://www.primante3d.com/valves-covid19-16032020/>

Ressources

Groupe(s) Facebook

<https://www.facebook.com/groups/1120744844933688/>

Source(s) documentaire(s)

<https://pad.degrowth.net/nTtnXZiKT4a-Rir6PMPqUQ?view>

<https://www.facebook.com/CVUT.v.Praze/posts/10158076692324084>

Discord

<https://discordapp.com/invite/N9PANj2>

Slack

<https://helpfulengineering.slack.com/>

Jogl

<https://app.jogl.io/project/130>

Visières

Visières

Visière LAHCEN

Visières

Liens / Inspirations

<https://www.protohaven.org/proto-shield/>

<https://vimeo.com/165531373>

https://www.reddit.com/r/lasercutting/comments/fs0ie3/lasercut_ppe_face_shield_based_off_the_prusa_and/



<https://gitlab.com/volumes1/visi-re-plexi-volumes/-/blob/master>


FOLDED

- Shield Face -


MATÉRIEL



Découpe laser
50x25cm (min)



P.E.T ou polypropylène
épaisseur 0.5-1.5mm
720x250mm



Rhodoïd
A4




Élastique

FABRICATION




disponible sur GitLab.com

=  **x11**
5 minutes

Réglage LASER - à titre indicatif -	
Découpe réaliser sur :	
TROTEC Speedy 300	
Puissance	100%
Vitesse	3mm/s

MONTAGE

- 1** Plier **pièce A** sur les traits de pliage



- 4** Amener la languette de la **pièce A** dans l'encoche de la **pièce B**

- 2** Insérer la **pièce B** au niveau de l'encoche



- 5** Sortir les encoches de la **pièce A**

- 3** Glisser le **Rhodoïd** dans le pli de la **pièce A**



- 6** Ajouter un **élastique** sur les encoches




Visières

LABSud V1 - Découpée laser - PETG 1mm


Ce modèle utilise les feuilles de PETG 1 mm.





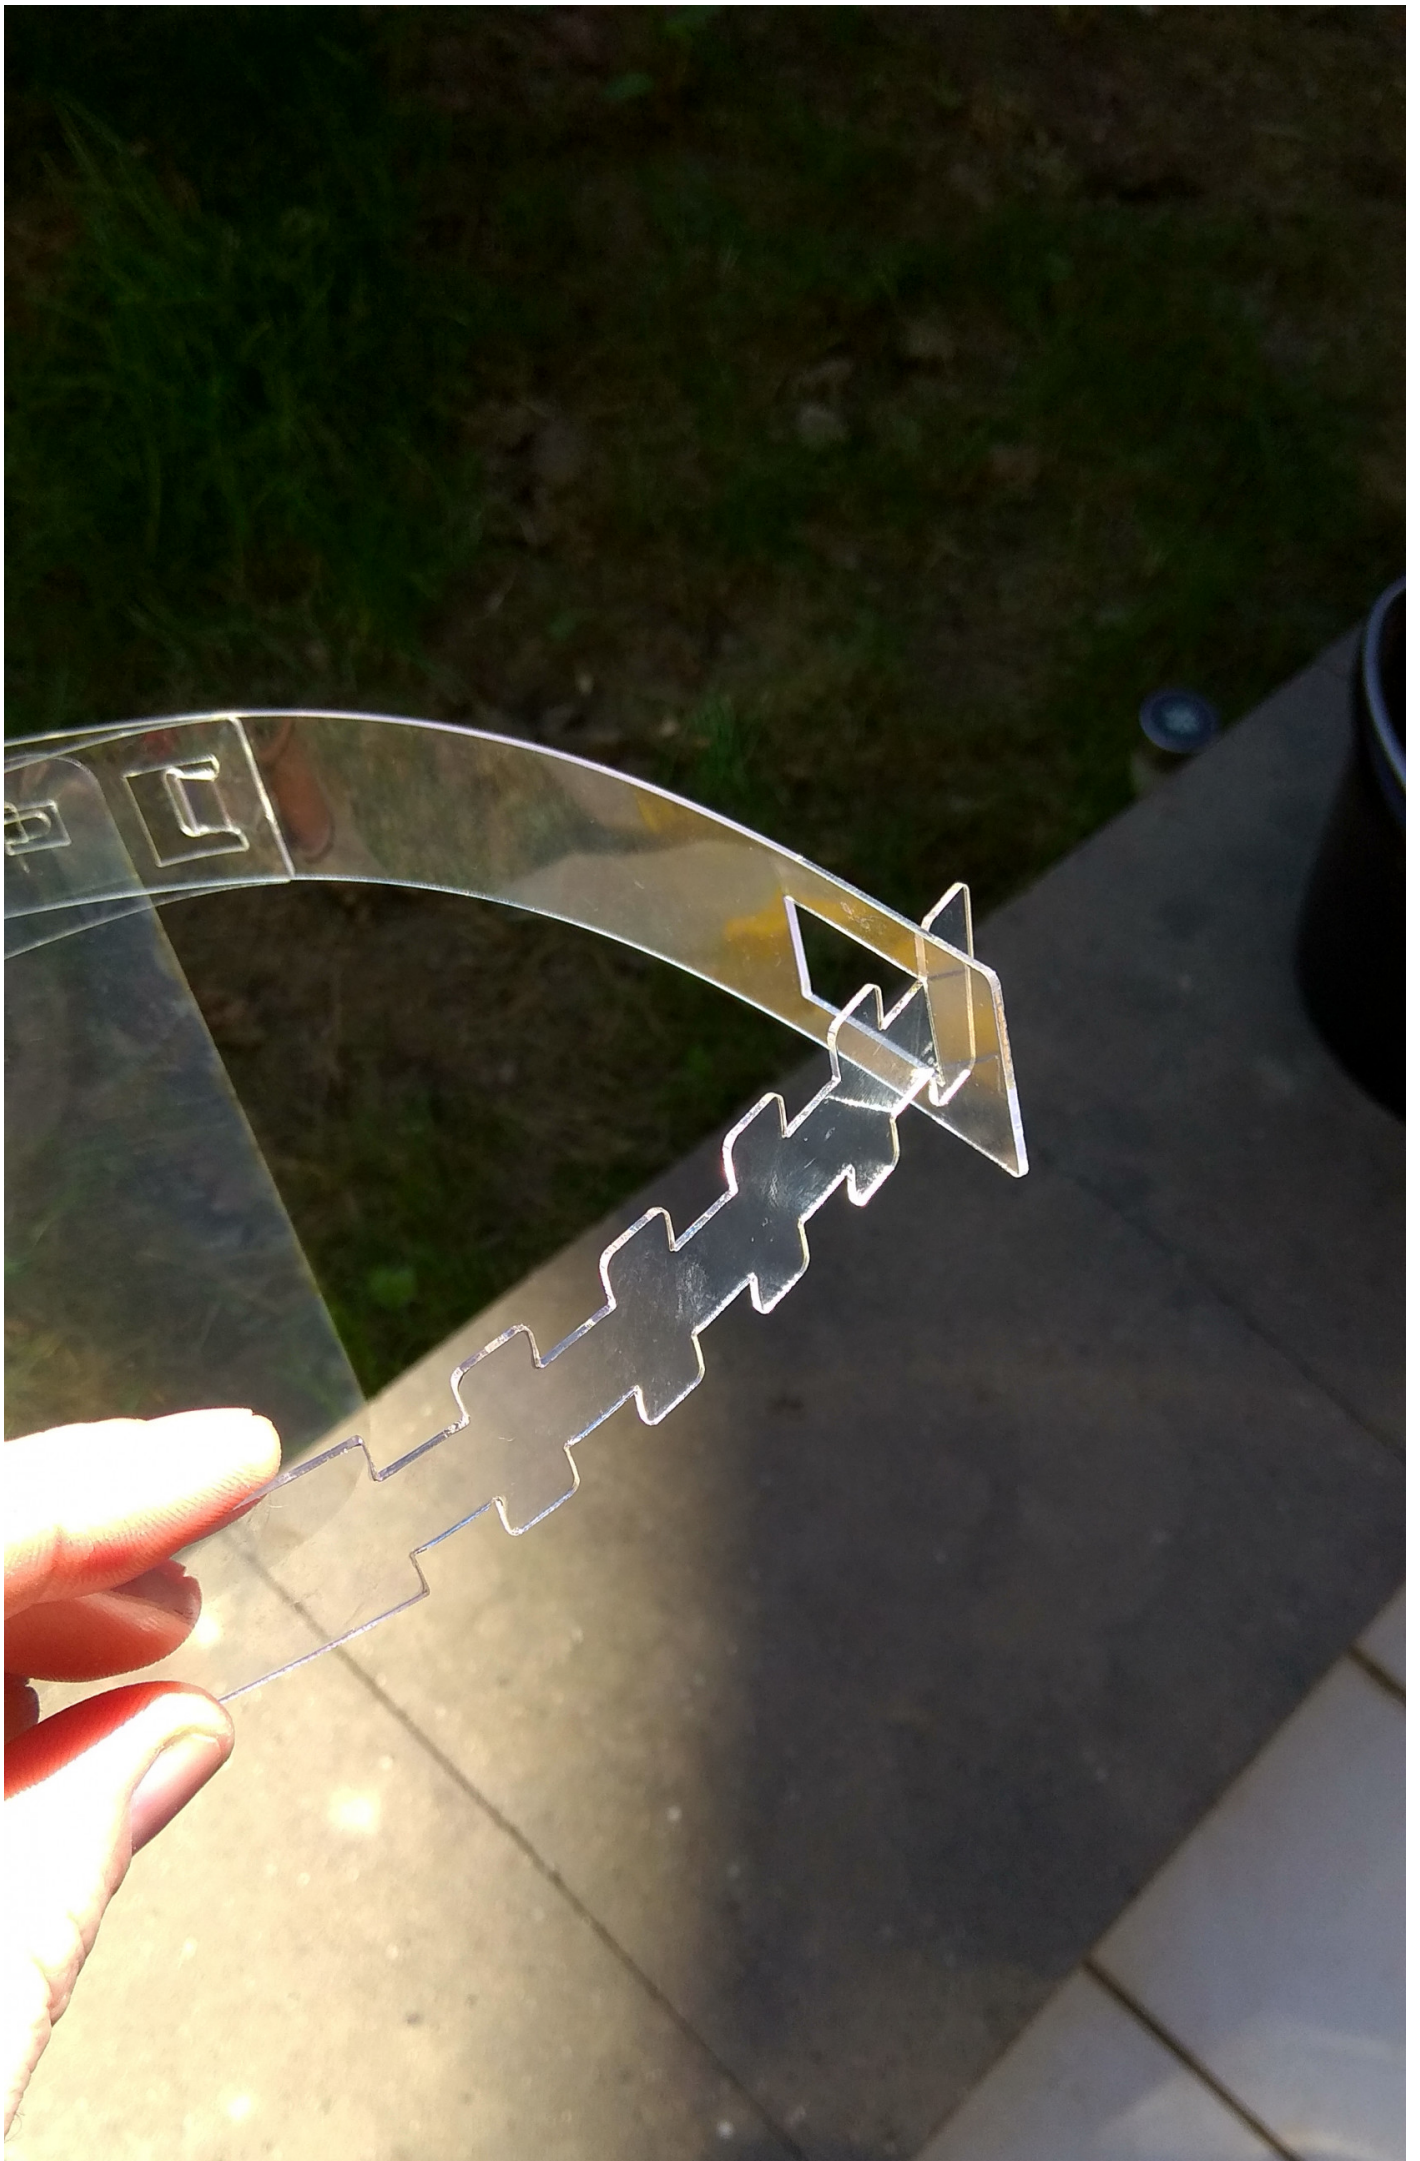




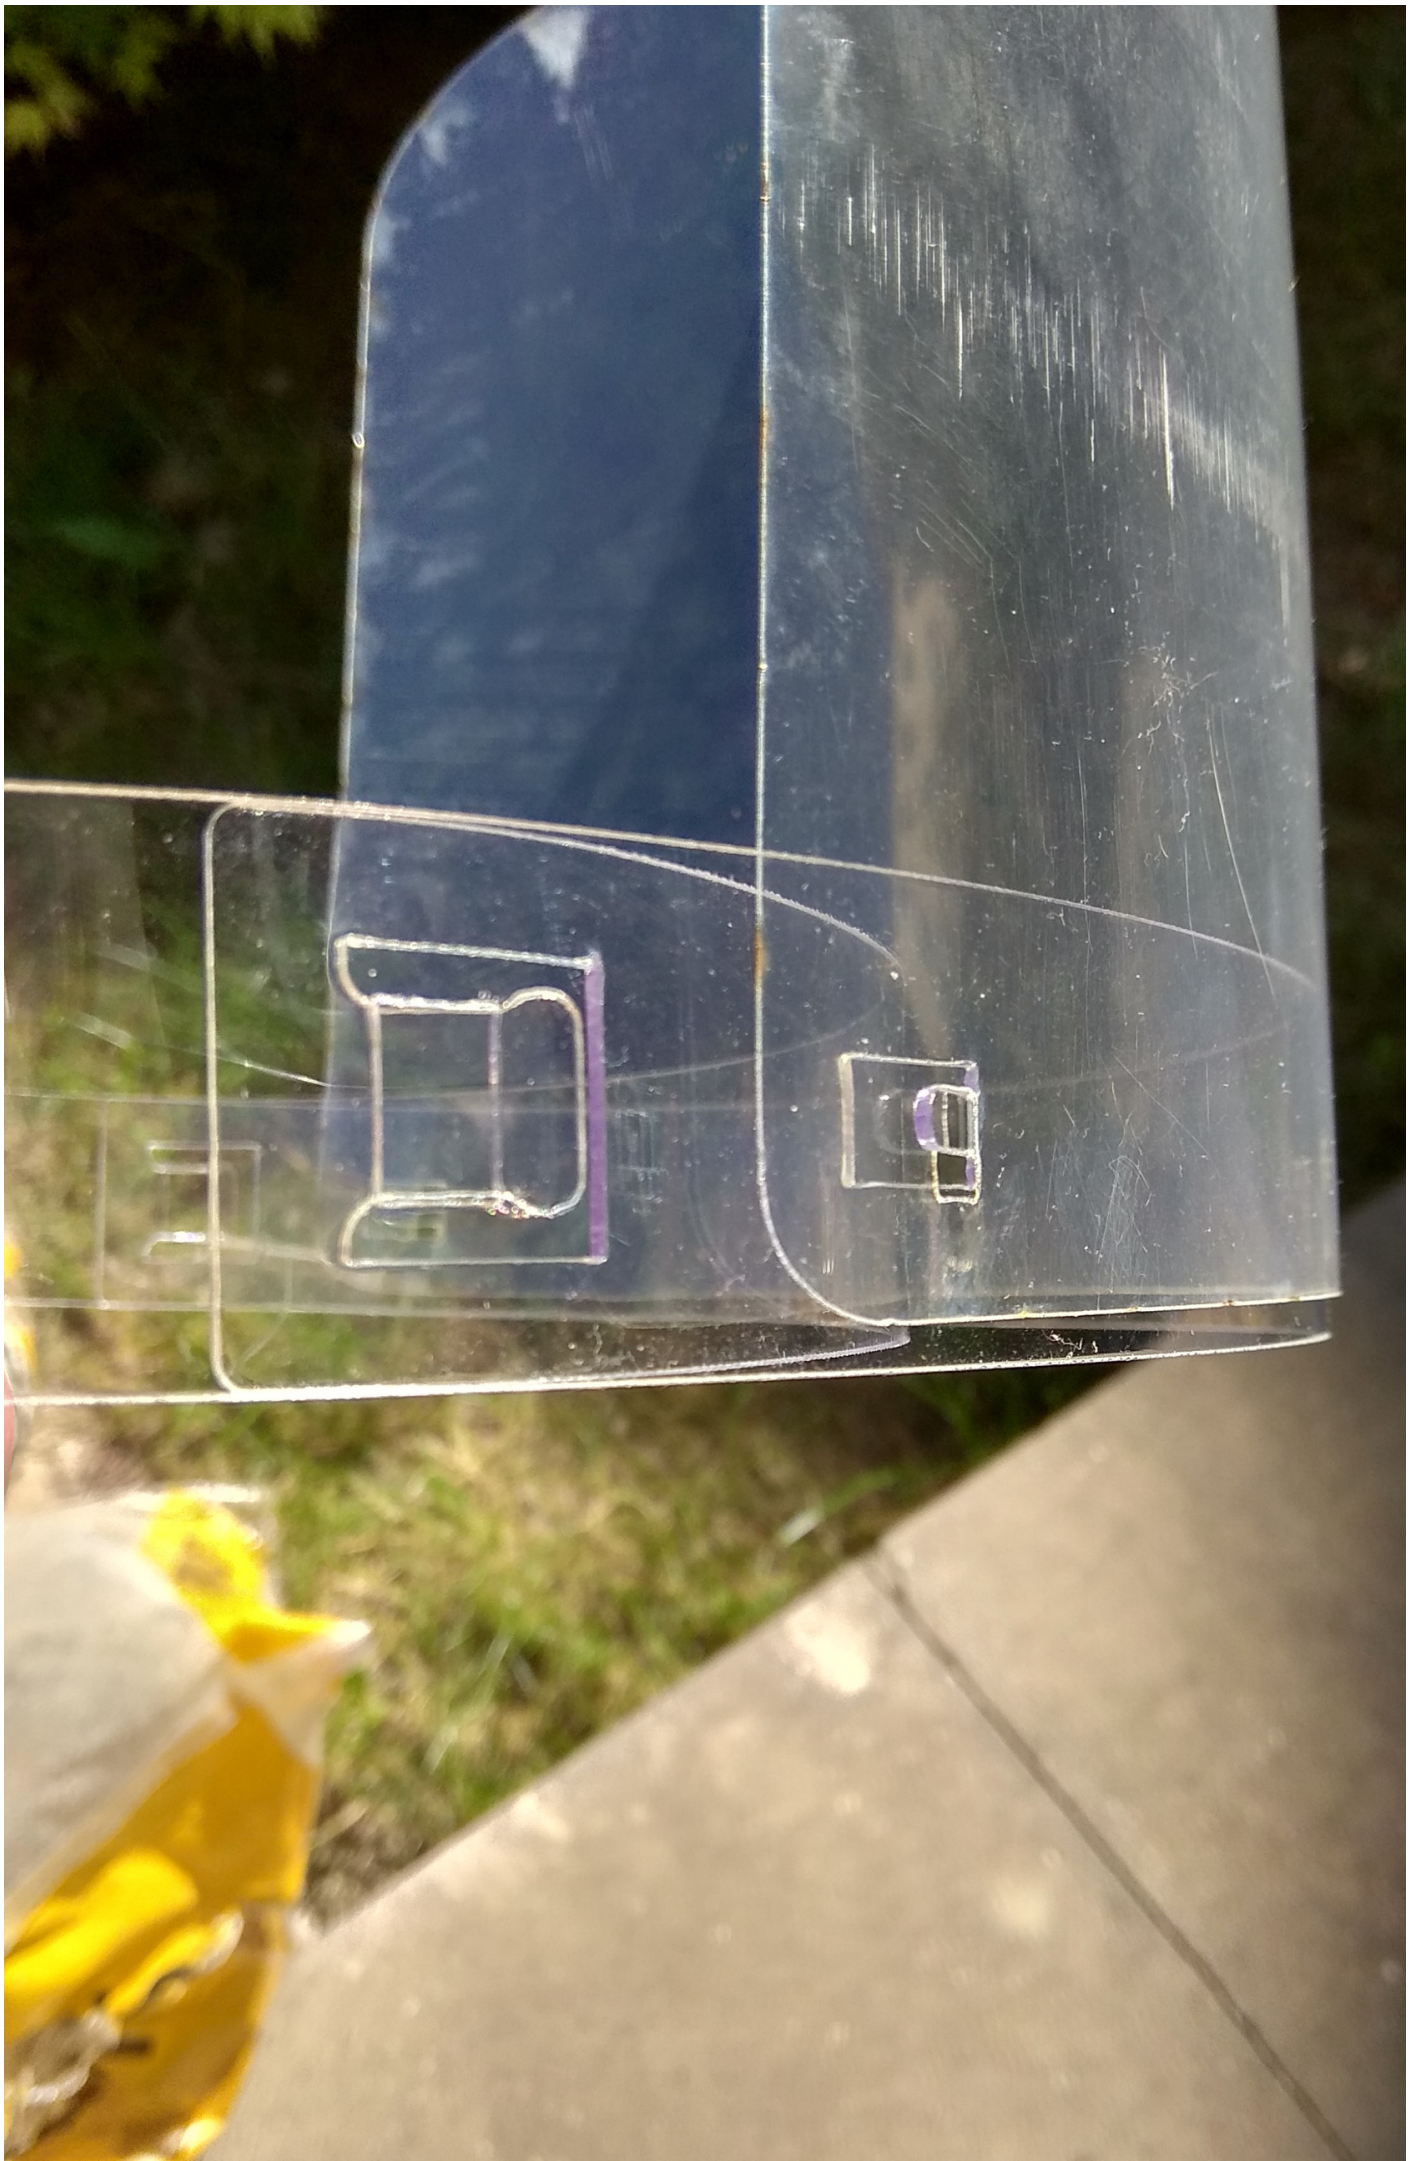





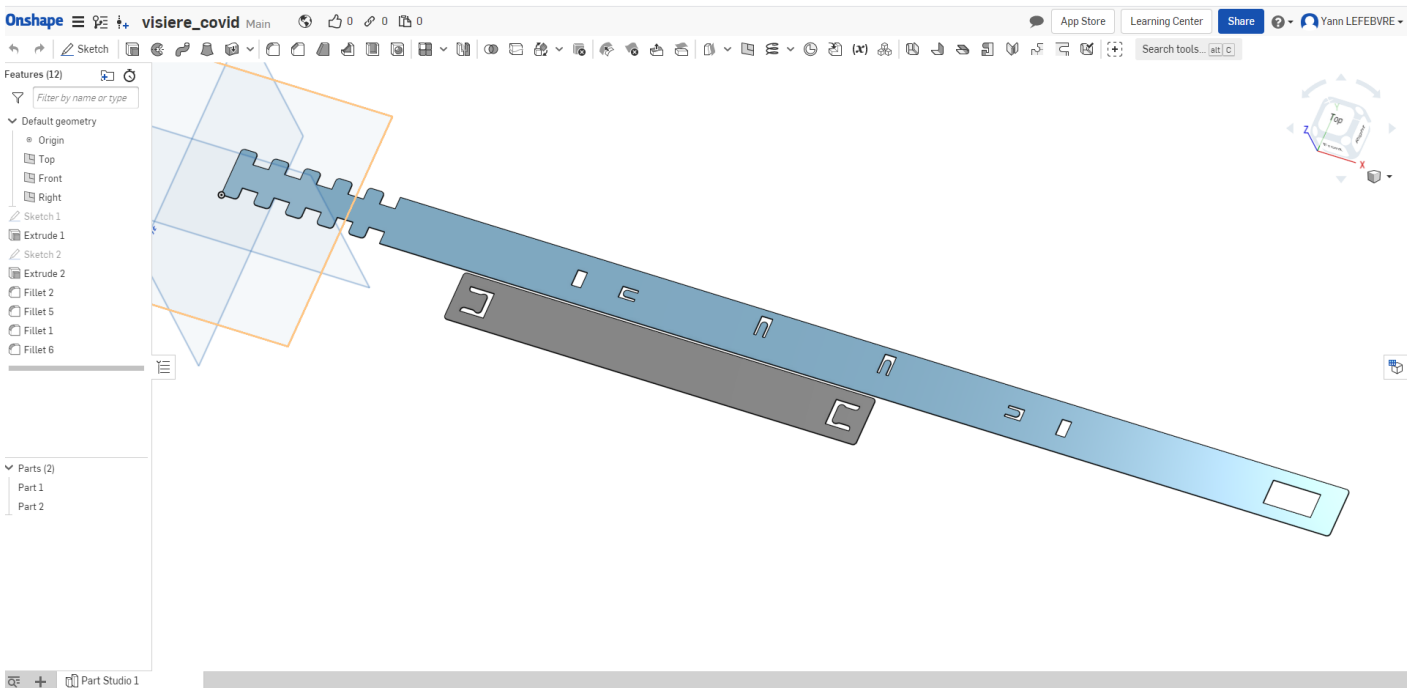

Principales caractéristiques

- Très rapide à découper : avec une panelisation, on est aux alentours de 1 minute / visière sur une découpeuse laser 80W.
- Rentre sur des découpe laser de 700 mm de large.
- Montage très rapide : en sortie de laser on ôte les plastique de protection, et on monte les deux pièces (entre 10 et 20 secondes).
- Taille ajustable.
- Aucune autre composant nécessaire (mise à part le plastron interchangeable évidemment).
- Confortable et légère.
- Résistante.
- Uniquement en PETG : désinfection facile.

Point d'amélioration possible

- La mise en place du plastron n'est pas fastidieuse mais je pense qu'on peut mieux faire.

Liens

[Lien CAO sur Onshape](#)

[Lien vers le dossier cloud](#)

Visière LABSud MdWAM dit "B"

Matériaux :

Ce modèle utilise des plaques de PETG 1 mm et des feuilles de PP de 100 microns.

(Photo "20200407_181226.jpg" et "20200407_181237.jpg")

Caractéristiques :

Ce modèle possède deux pièces et 4 pinces pour tenir l'écran.

- Rapide à fabriquer : (temps unitaire à venir)
- Rentre sur des découpes laser de 700 mm de large. (taille unitaire à venir)
- Montage rapide : en sortie de laser on ôte les plastique de protection et on monte les deux pièces puis l'écran (entre 10 et 20 secondes).
- Autre composant nécessaire : le plastron interchangeable et un élastique.
- Confortable et légère.
- Résistante.
- PETG et PMMA : désinfection facile.
- Les pinces permettent un maintient optimal de l'écran.

Fichiers :

Les noms des fichiers du modèle sont établis comme suit :

"Nom.du.modèle_Nom.de.la.pièce_Nom.de.la.plaque_Nom.institution_nombre.de.pièce.par.plaque.rld"

par exemple : "B_GRAND_P_CHU_x20.rld" (à vérifier)

Liens vers le dossier du cloud (à venir)

Fabrication :

[Voir la documentation du process de fabrication](#)

Temps de fabrication unitaire : (à venir)

Temps de fabrication par plaque : (à venir)

Nombre au m² : (à venir)

Montage :

(photo ou vidéo à venir)

Liens :

Lien du modèle de base (à venir)

Visière LABSud MA dit "A"

Matériaux :

Ce modèle utilise des plaques de PETG 1 mm et des feuilles de PP de 100 microns.

(Photo "20200407_181410.jpg")

Caractéristiques :

Ce modèle possède une pièce et un écran.

- Rapide à fabriquer : (temps unitaire à venir)
- Rentre sur des découpes laser de 700 mm de large (taille unitaire : à venir)
- Montage très rapide : en sortie de laser on ôte les plastiques de protection et on monte l'écran (entre 10 et 20 secondes).
- Taille ajustable.
- Aucune autre composant nécessaire (mise à part l'écran interchangeable)
- Confortable et légère.
- Résistante.
- Uniquement en PETG : désinfection facile.

Fichiers :

Les noms des fichiers du modèle sont établis comme suit :

"Nom.du.modèle_Nom.de.la.plaque_Nom.institution_nombre.de.pièce.par.plaque.rld"

par exemple : "A_P_CHU_x20.rld" (à vérifier)

Liens vers le dossier du cloud (à venir)

Fabrication :

[Voir la documentation du process de fabrication](#)

Temps de fabrication unitaire : (à venir)

Temps de fabrication par plaque : (à venir)

Nombre au m² : (à venir)

Montage :

<https://doc.labsud.org/books/lutte-contre-le-coronavirus/page/mode-d-emploi-pour-monter-la-visiere-alpha>

Liens :

<https://fablab-ulb.gitlab.io/projects/coronavirus/protective-face-shields/PFC-Headband-Flexible-LaserCut/tuto-fr/>

<https://cloud.labsud.org/index.php/s/oW43ZQY366cAtXw>

Process de fabrication des visières et masques à LABSud

Matériaux :

Les visières sont découpées à la découpeuse laser en PETG 1 mm.

Les plaques de PETG 1mm ont été achetées chez [Richardson-plastiques](#) à Béziers.

Les écrans sont découpés à la découpeuse laser en PP de 100 microns.

Le rouleau de PP a été acheté chez ... (à venir)

Les pinces pour le modèle B sont découpées à la découpeuse laser en PMMA 3 mm.

Le PMMA a été acheté chez ... (à venir)

[Les matériaux de fabrication des masques tissus se trouvent ici](#)

Découpe des planches de PETG 1 mm :

La découpe optimisée des plaques de 205x122 cm se fait comme suit :

(Photo à venir)

- Les plaques nommées "P" (72x51.25cm) sont destinées en priorité à la petite laser 80W.
- Les plaques "P1" (72x53cm) sont destinées en priorité à la grande laser 180W.
- Les plaques "C" (61x53cm) sont des chutes.
- A noter que toutes les plaques peuvent rentrer dans les deux machines découpeuses laser de LABSud bien que la surface de travail de la 80W soit de 70x50cm (il restera des bandes de chutes, qu'il faudra ranger dans "la boîte à chute" qui se trouve dans l'atelier).


Une fois la découpe réalisée, noter le nom des planches "P", "P1" ou "C" sur les coupes et les entreposer près des machines.

Découpe des planches de PETG 1.5 mm :

La découpe optimisée des plaques de 205x122 cm se fait comme suit :

Tracé des plaques pour les visières coupées à la laser PETG 1.5mm

Commencer par couper la plaque en deux en suivant le trait épais
vous n'aurez besoin que de 3 côtes pour la totalité de la découpe.

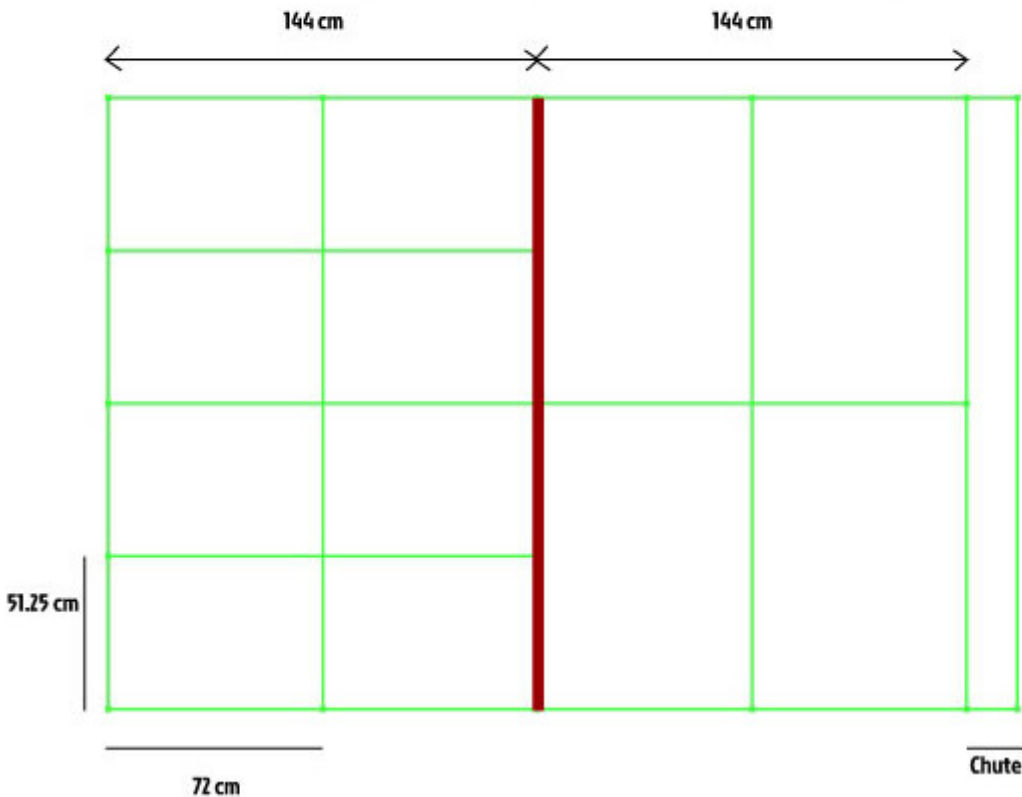

- Les plaques nommées "P" (72x51.25cm) sont destinées en priorité à la petite laser 80W.
- Les plaques "P1" (72x53cm) sont destinées en priorité à la grande laser 180W.
- Les plaques "C" (61x53cm) sont des chutes.
- A noter que toutes les plaques peuvent rentrer dans les deux machines découpeuses laser de LABSud bien que la surface de travail de la 80W soit de 70x50cm (il restera des bandes de chutes, qu'il faudra ranger dans "la boîte à chute" qui se trouve dans l'atelier).

Une fois la découpe réalisée, noter le nom des planches "P", "P1" ou "C" sur les coupes et les entreposer prêt des machines.

Modèles :

Suite aux demandes du CHU, de l'APF, de l'AFM etc... LABSud a prototypé et fabriqué différents modèles.

- Le "MA" qu'on appellera le "A"

[Documentation du modèle](#)

- Le "MdWAM" qu'on appellera le "B"

[Documentation du modèle](#)

- Le LABSud V1 (YL design) qu'on appellera le "C"

[Documentation du modèle](#)

- Les masques en tissus qu'on appellera "T"

[Le process de fabrication des masques tissus se trouve ici](#)

Ces institutions ont retenu pour l'heure le modèle A.

Note : le modèle B est pris par le DAR ? (à corriger)

Références :

Pour le suivi de la fabrication et des retours, chaque jour de production (or samedi et dimanche sauf exception) portera un code et devra être gravé sur la production suivi du code du modèle.

- 1 = lundi 13 avril 2020
- 2 = mardi 14 avril 2020
- 3 = mercredi 15 avril 2020 ...

Exemple : Production du modèle "MA" le lundi 13 avril 2020, il faudra inscrire sur tous les éléments de la production : "1A"

[Lien vers les références](#)

Note : La production a commencé plus tôt, les précédentes fabrications ont la date du jour et le nom du modèle de base inscrit.

Suivi des commandes :

A chaque nouvelle demande, proposer les différents modèles ou voir le stock.

Noter sur le tableau blanc : (photo à venir)

- le nom de l'institution/entreprise/corps de métier ou personne
- La date de commande
- La deadline s'il y en a une
- Le nom du modèle choisi
- Le nombre

Reporter tous les renseignements dans [le tableau des commandes](#)

On pourra effacer sur le tableau blanc petit à petit, les commandes livrées pour permettre aux personnes de voir l'historique des jours précédents. Il faudra imprimer la feuille du [tableau des commandes](#) de temps en temps pour montrer l'avancement.

Une feuille de décharge devra être signée par les organismes lors de la livraison (à déterminer) ainsi que la feuille de don dans les cas concernés.

Préparation des fichiers :

Les fichiers seront préparés en amont pour gagner en rapidité de production le jour même.

- Paramètres indicatifs pour la 180W : (à venir)
- Paramètres indicatifs pour la 80W : (à venir)

Les paramètres de vitesse et de puissance pour les machines sont normalement enregistrés directement dans le fichier .rld mais **attention** selon le nettoyage, la focale bien calibrée et d'autres paramètres il est possible que **les plaques soient mal découpées ou brûlées : Il faudra toujours faire des vérifications.**

Les logos des institutions ainsi que de l'association sont également disponibles avec une police en uni trait pour gagner du temps en gravure : [Lien vers le dossier du cloud](#)

Note : La police "simplex" disponible sur laserwork (pas du lab), inkscape ou [téléchargeable sur ce site](#) permet de faciliter la mise en forme de la police en uni trait pour réduire le temps de gravure.

Sur laserwork, une fois le texte créé avec la police "simplex" utiliser la fonction "ungroup" puis la fonction "delete overlap" permet de réduire rapidement le nombre de trait après quelques tests de paramètre. Puis utiliser la fonction "combine curve" permet de rejoindre les traits pour optimiser le déplacement.

Changement de référence sur les modèles :

- Pour le modèle A : Pour une police "simplex" de 8 mm de haut (dimensions en haut à gauche pas dans l'éditeur de texte), la matrice doit être espacée de 17 mm. (à confirmer)
- Pour le modèle B : (A compléter)

Gestion des équipes :

Toutes les personnes présentes doivent signer la feuille de présence, puis se laver les mains. Ensuite elles enfilent un masque et une visière.

Les personnes sont réparties selon le nombre :

- 1 à 2 personnes sur les machines de découpe laser
- 1 personnes s'il faut pour la découpe des plaques

- Les autres seront placés sur les tables d'atelier (espacées d'au moins 1m) pour la préparation des commandes

Note : A chaque pause (environ toutes les heures), toutes les personnes doivent se laver les mains avant et après la pause.

Vers 17h, les équipes s'arrêtent pour procéder au nettoyage et l'entretien (voir plus bas).

Une photo de groupe est faite pour garder un souvenir du travail ensemble et communiquer sur l'investissement des personnes et de LABSud.

Note : le responsable d'équipe (à déterminer) est en charge du brief des participants, de veiller au respect des consignes et des mesures d'hygiène, à la bonne marche de la fabrication et au suivi des commandes et de la production ainsi qu'aux demandes et au questionnement de chacun.

Fabrication :

Tous les fichiers (.rld et .dxf) pour découper les modèles dans les découpeuses laser sont disponibles dans le drive (lien à venir) et le freebox server accessible à partir du réseau dans les locaux de LABSud et sur tous les ordis du LAB.

Les noms des fichiers des modèles sont établis comme suit : "Nom.du.modèle_*Nom.de.la.pièce*_Nom.de.la.plaque.à.utiliser_Nom.institution_nombre.de.pièce.par.plaque.rld"

* Seulement si le modèle possède plusieurs pièces.

par exemple : "B_GRAND_P_CHU_x20.rld" (à vérifier)

- Placer la plaque de PETG correspondante ou dérouler le rouleau de PP dans la machine et ouvrir le fichier adéquate ou se référer [au process de fabrication des masques tissus](#).
- Vérifier l'alignement du matériaux avec les grilles et la tête et vérifier les paramètres.
- Puis envoyer le fichier.

Note : Il est possible que le logiciel marque un message d'erreur "Quit processing" appuyer sur "stop" et relancer. Si le problème persiste redémarrer les ordis ou lancer le travail par morceaux ou par calque.

- Une fois le travail terminé, vérifier que toutes les coupes et gravage ont bien été réalisés correctement sinon relancer en fonction.
- Sortir les éléments de la machine et les amener sur les tables pour retirer le plastique et les morceaux.
- Noter sur le tableau de suivi de production à l'aide d'une barre dans la case correspondante (photo à venir)
- Enlever le plastique et les morceaux détachables des différents éléments et veiller à ce qu'il n'en reste pas sur les gravures.
- Packager dans des sacs refermables les éléments par 25 (à confirmer) avec élastiques pour les structures, par 30 (à confirmer) pour les écrans et par multiples de 100 (à

confirmer) pour les pinces du modèle B. Ecrire sur les sacs le nombre et la destination (institutions ou demandeurs)

- Entreposer les sacs sur la table "commande en cours" sous le nom de la commande (photo exemple à venir) jusqu'à ce que la commande soit finalisée.
- Une fois la commande finalisée, la placer dans les emplacements prêts à partir prêt de l'entrée(photo à venir)

Note : S'il y a du surplus de production, les placer sur la table "stock" packagés d'un élastique ou dans des sacs par groupes comme cité ci-dessus. Si certains éléments sont peu esthétiques ou non adéquates à pour les institutions de santé par exemple(à déterminer...) placer les sur la tables stocks avec un scotch à donner... Ils pourront être donné aux particuliers, professions en rapport avec le public etc... (à déterminer)

Suivi de la production :

A chaque sortie d'une plaque, d'écrans ou de masques en tissus de la machine, un trait est réalisé sur le tableau prévu à cet effet dans la case correspondante.

A la fin de la journée, faire le compte de la production et l'écrire sur le tableau à droite des commande de bas en haut (photo à venir). Reporter les résultats dans [le tableau de production](#). On pourra effacer un par un les comptes des jours les plus anciens une fois que ce côté de tableaux sera remplis pour permettre aux personnes de voir l'historique des jours précédents.

Les éléments sont conditionnés par paquet en sac refermables pour les livraisons. (Voir documentation des modèles)

Nettoyage et entretien :

Chaque jour en fin de journée :

- Les tables de travail sont nettoyées et désinfectées.
- L'aspirateur est passé dans tous les locaux.
- Les poubelles sont vidées.
- L'entretien des découpeuses laser est fait : nettoyage des miroirs et lentilles ainsi que des bacs à chutes. Les grilles doivent être nettoyées au minimum 1 fois par semaine.

Liens :

(à venir)

Visières


Mode d'emploi pour monter la visière Alpha



Vidéo (YouTube vidéo non-répertoriée) : <https://youtu.be/uXImFQyzLV0>


<https://www.youtube.com/embed/uXImFQyzLV0>

A - Etape 1

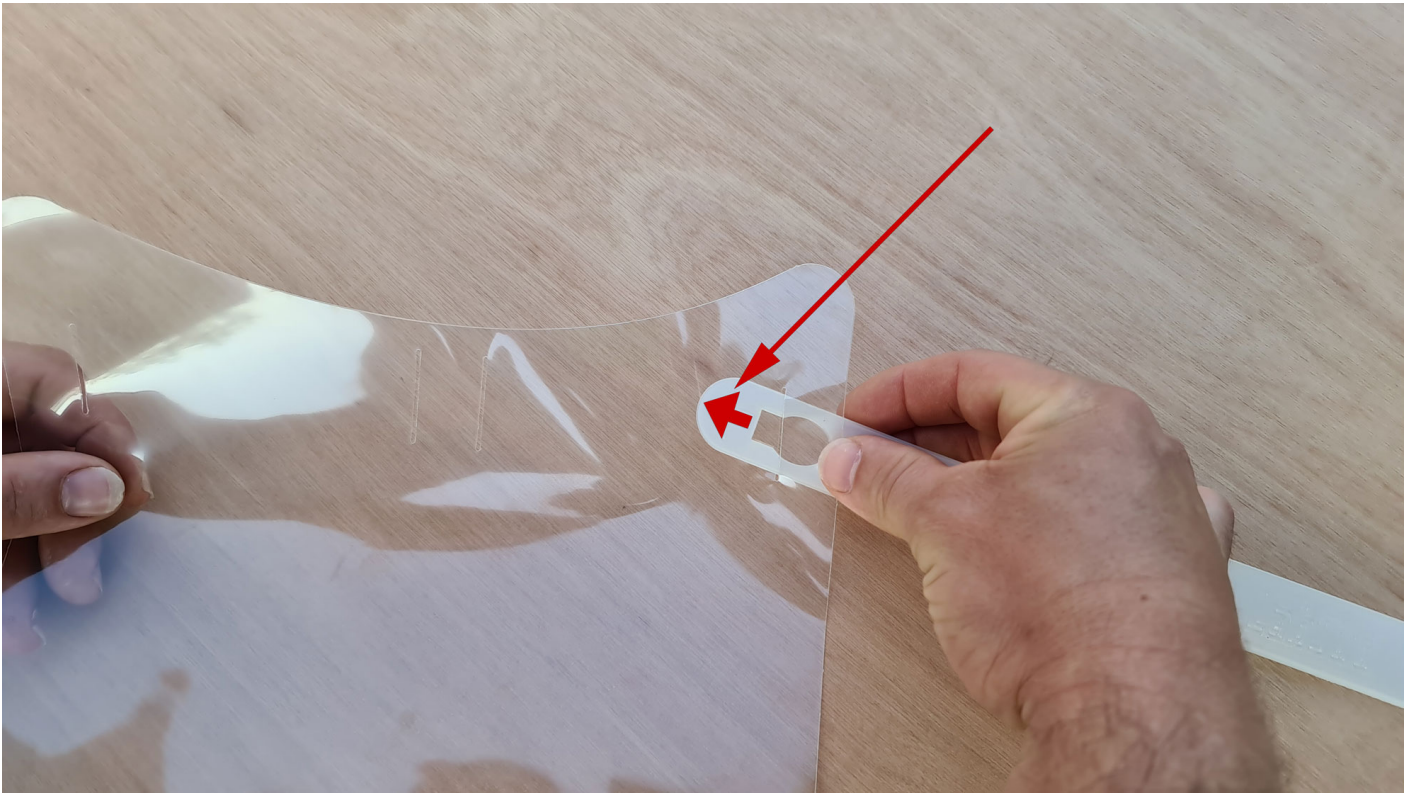


positionner l'écran devant soi et prendre le bandeau serre tête du côté où se trouve la flèche en venant l'insérer dans la première fente extérieure comme indiqué sur la photo. Veillez bien à passer par en dessous de façon à faire remonter la flèche, ainsi les étapes suivantes ne nécessiteront pas de retourner l'ensemble pour être réalisées.

B - Etape 2

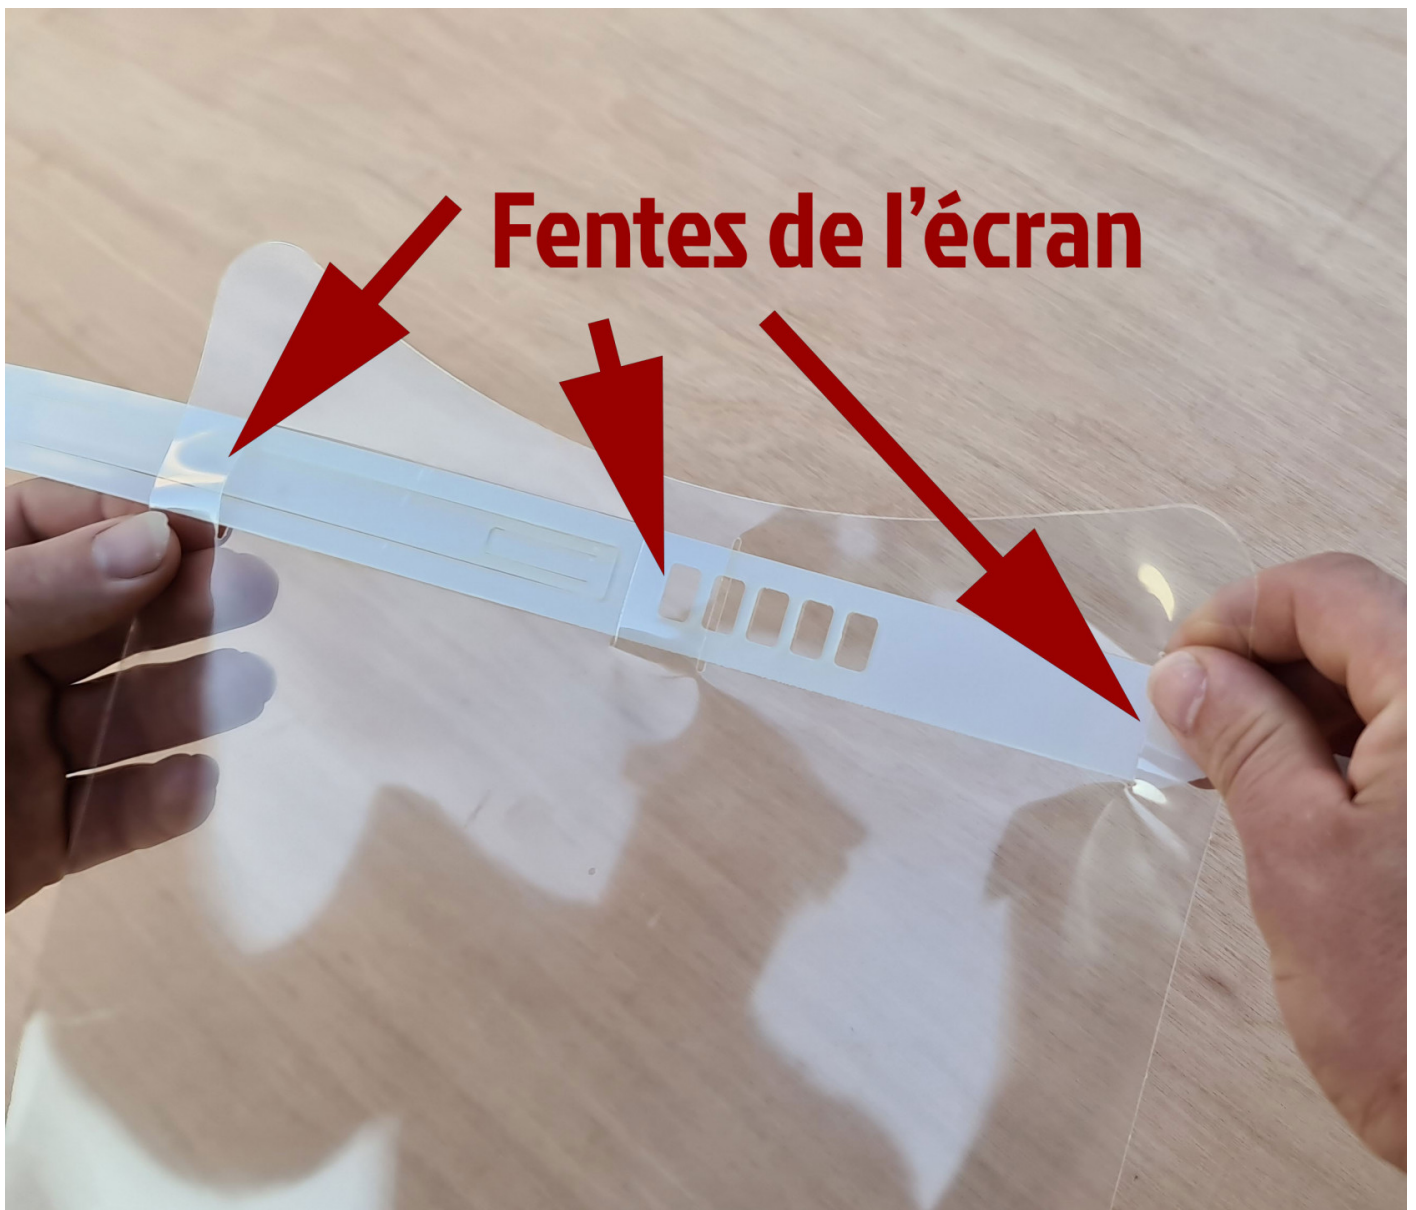

Faire glisser le bandeau serre tête jusqu' au bout dans les trois autres fentes de l'écran de la visière.


C - Etape 3

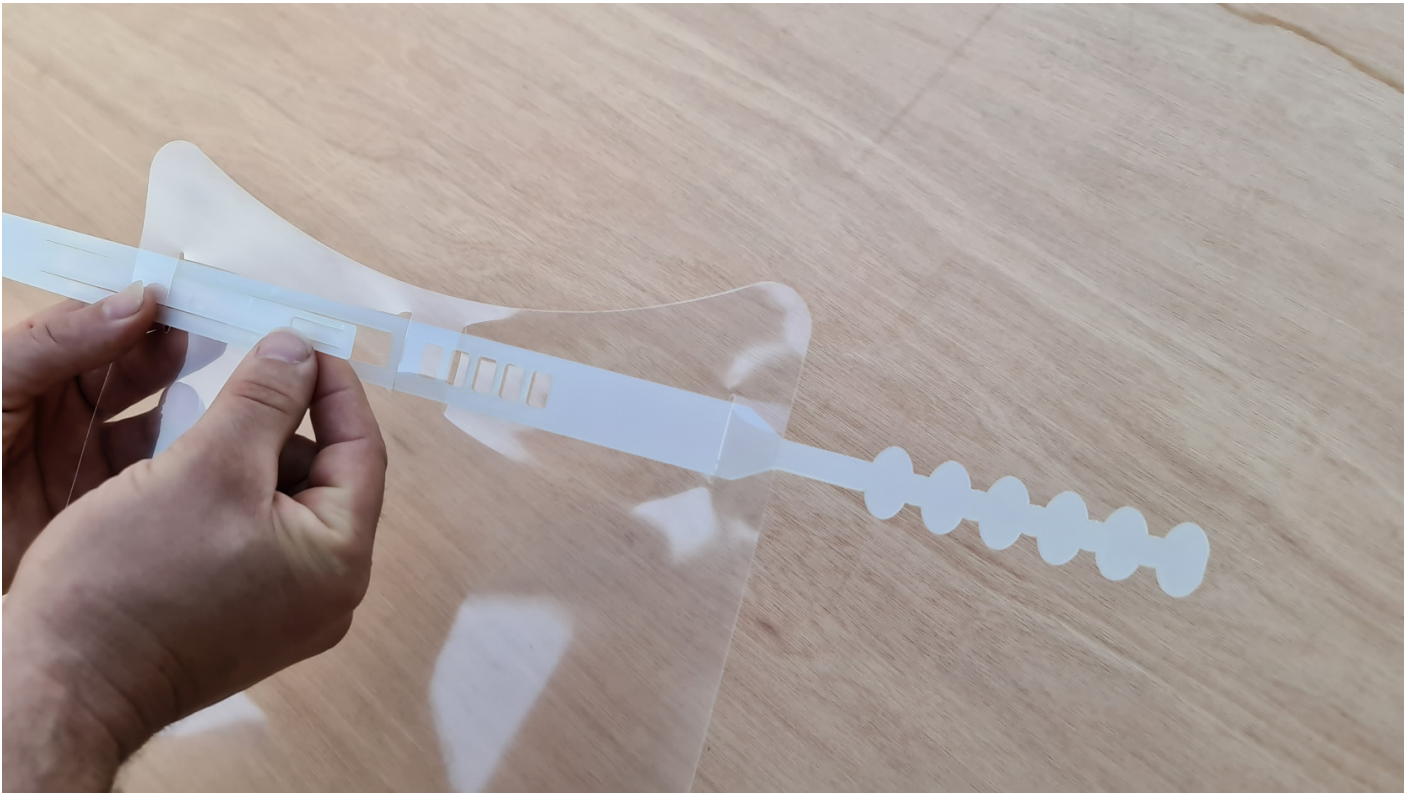


Continuer jusqu'à ce que la languette du bandeau ait légèrement dépassé les fentes du milieu.

D - Etape 4


La languette

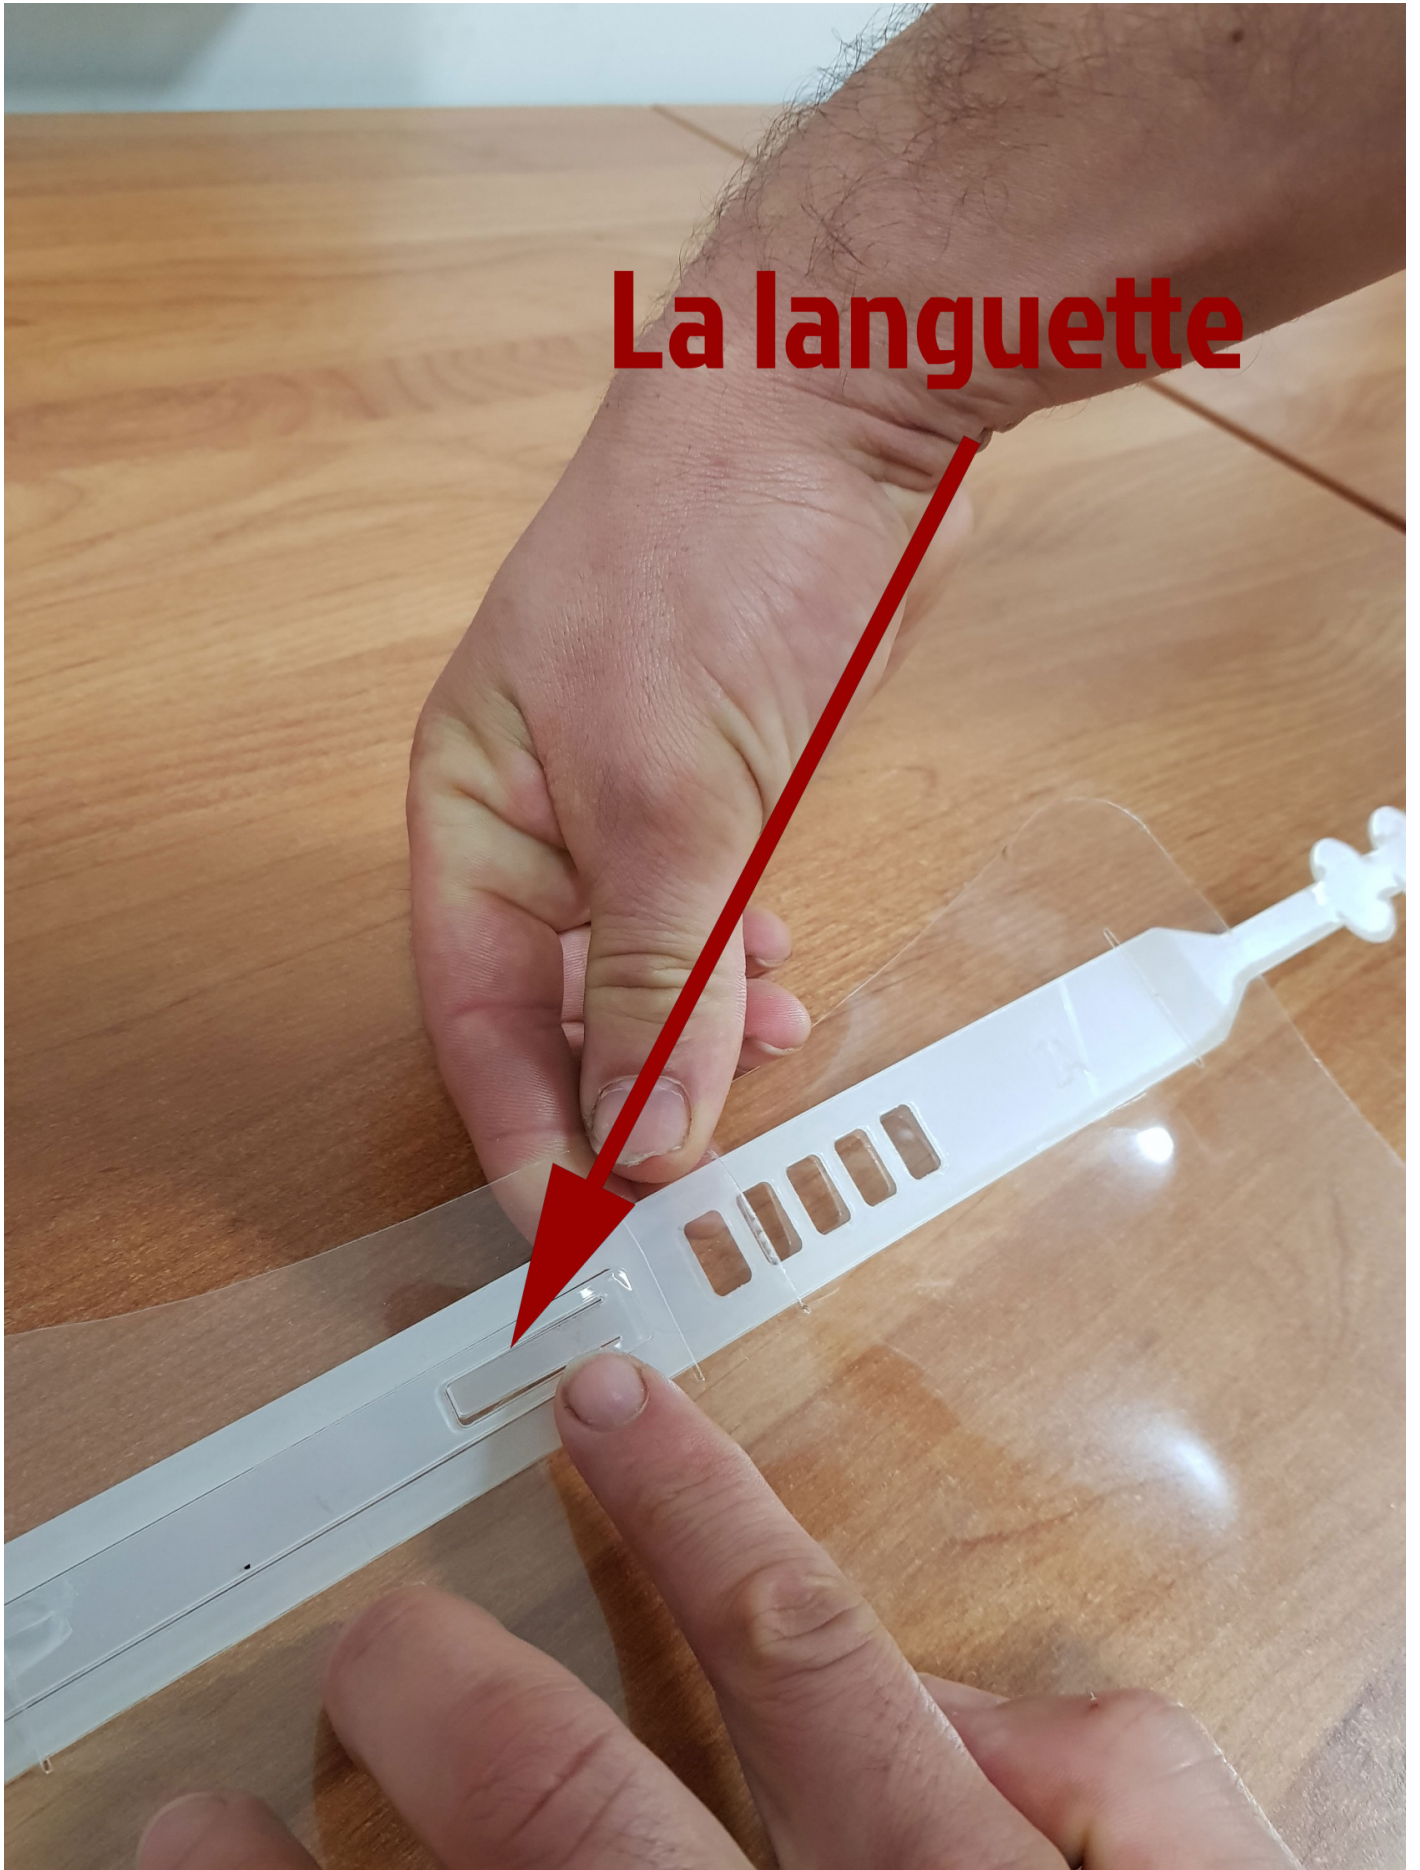

Languette

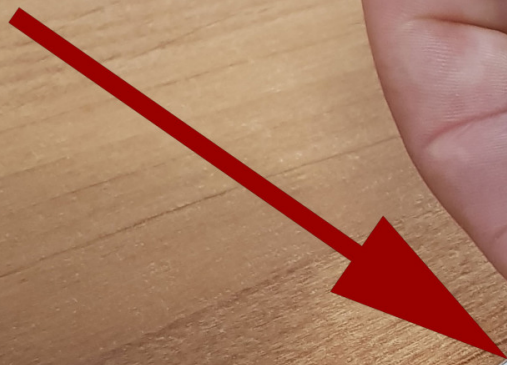

Fentes du milieu

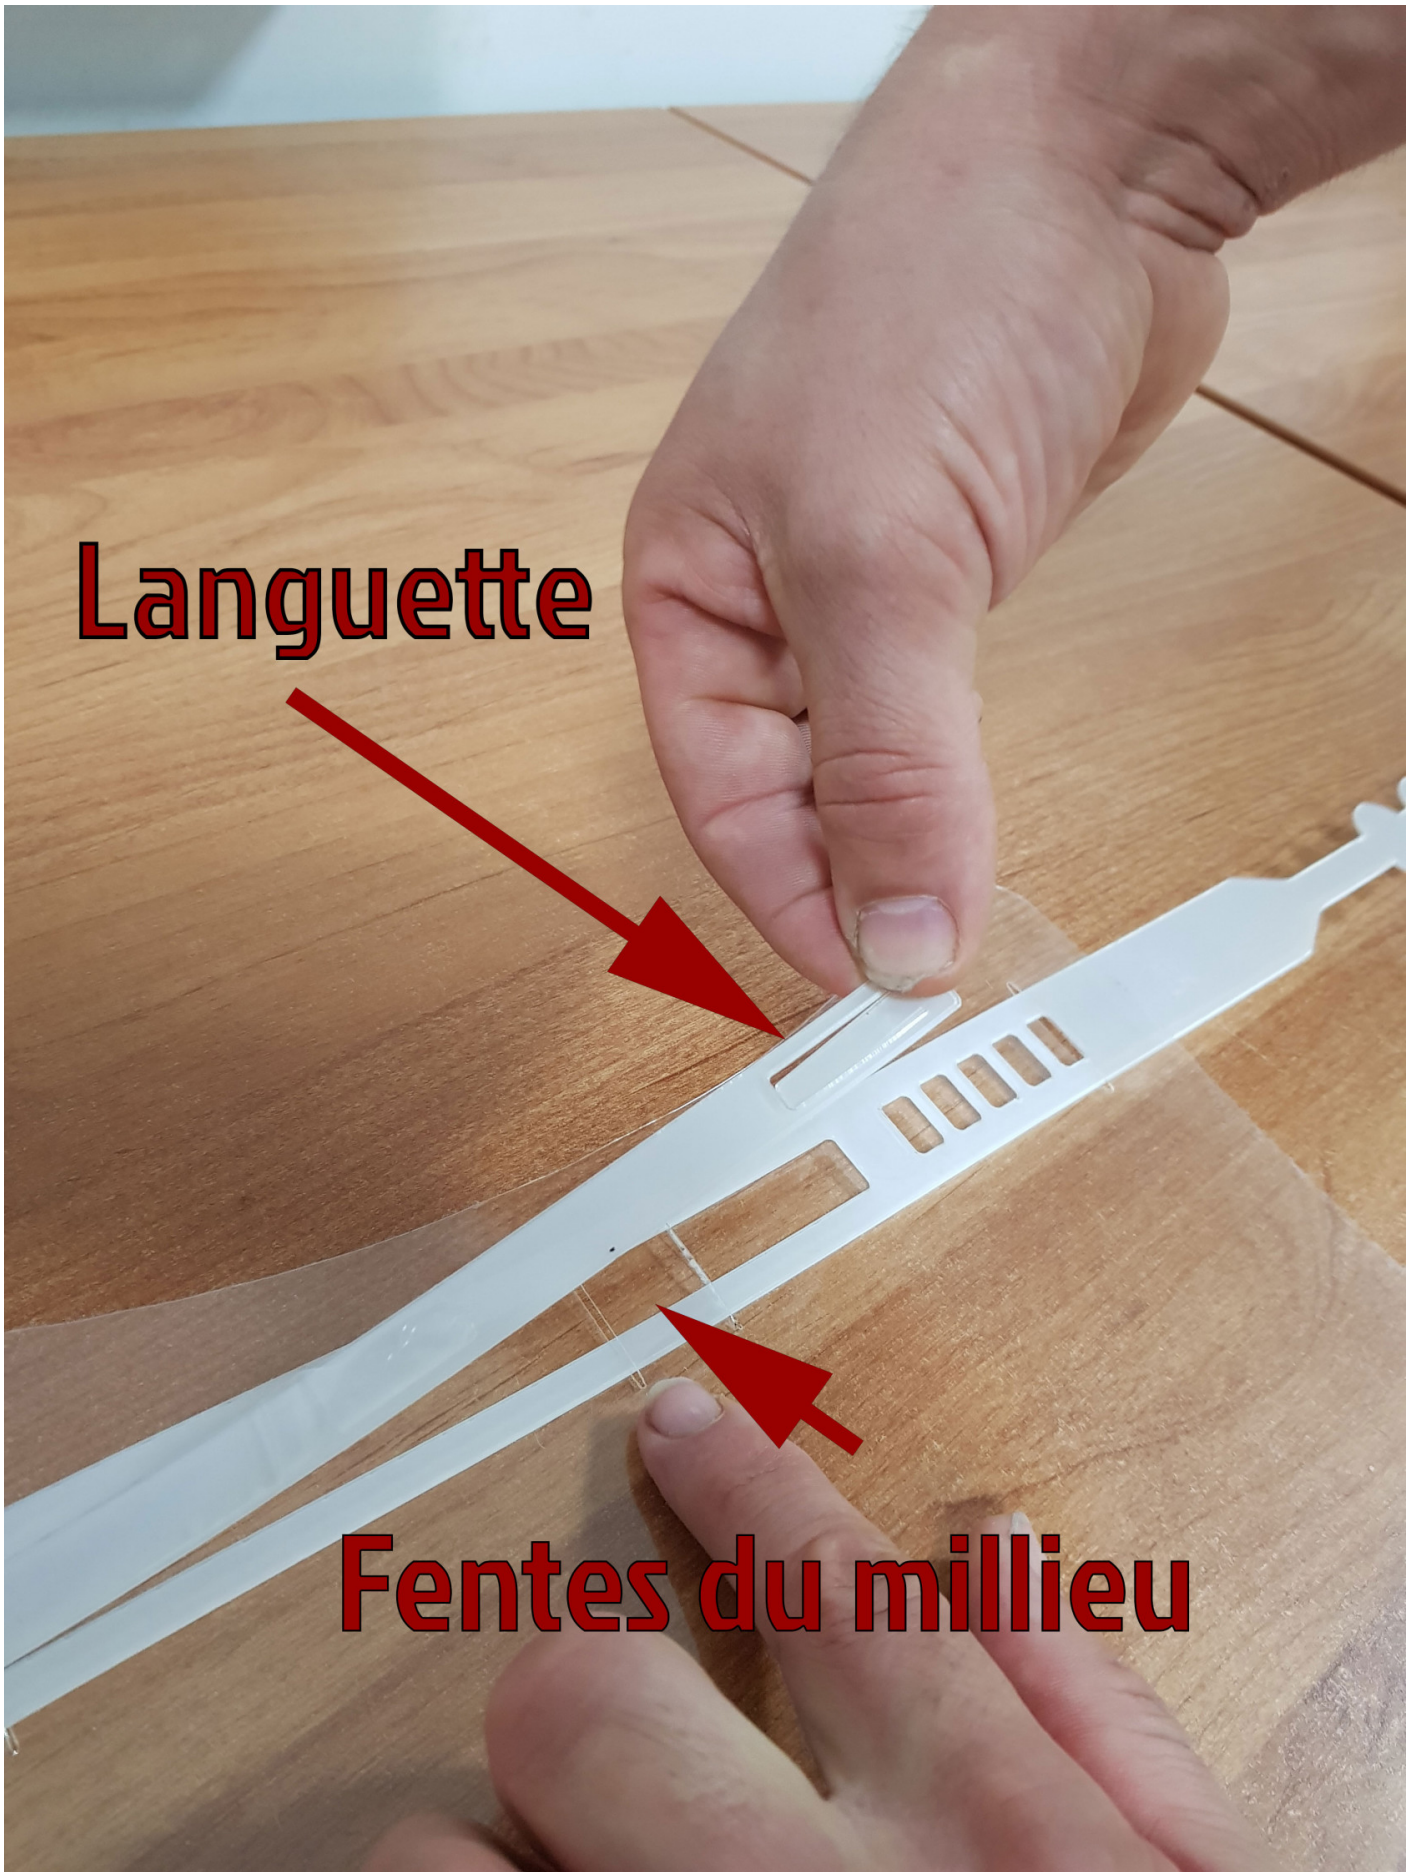


Récupérer le clips de la languette et revenir en arrière en relevant la languette au dessus des fentes centrales.

E - Etape 5 -



Insérer le clips de la languette dans un des trous prévus à cet effet en fonction de la distance souhaitez entre votre front et l'écran de la visière.

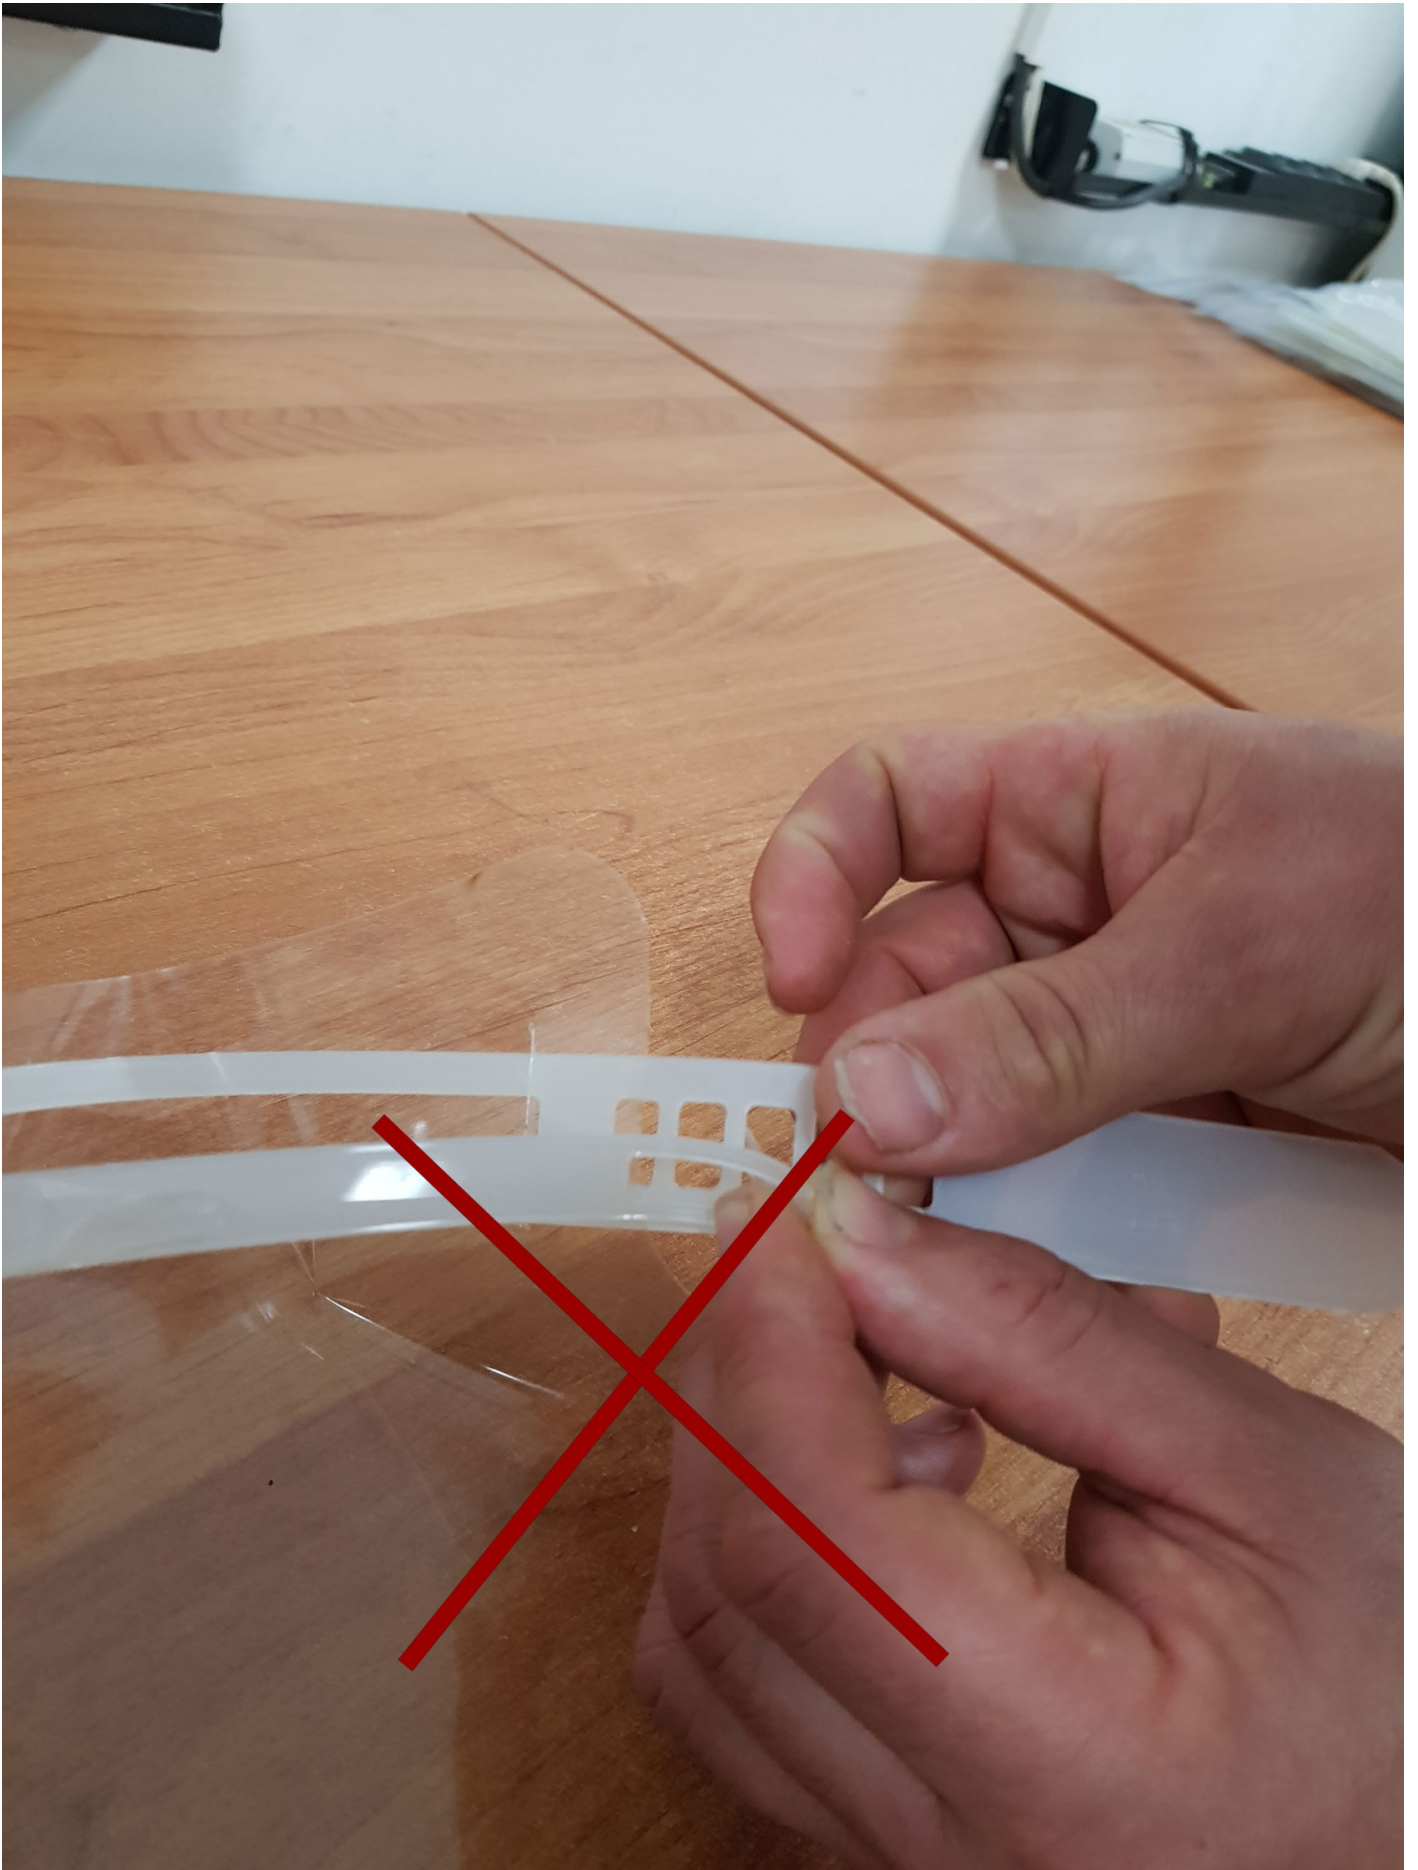


/!\ Ne pas dépasser l'écran de la visière pour insérer la languette !


F - Résultat



Ecouvillon / Swab



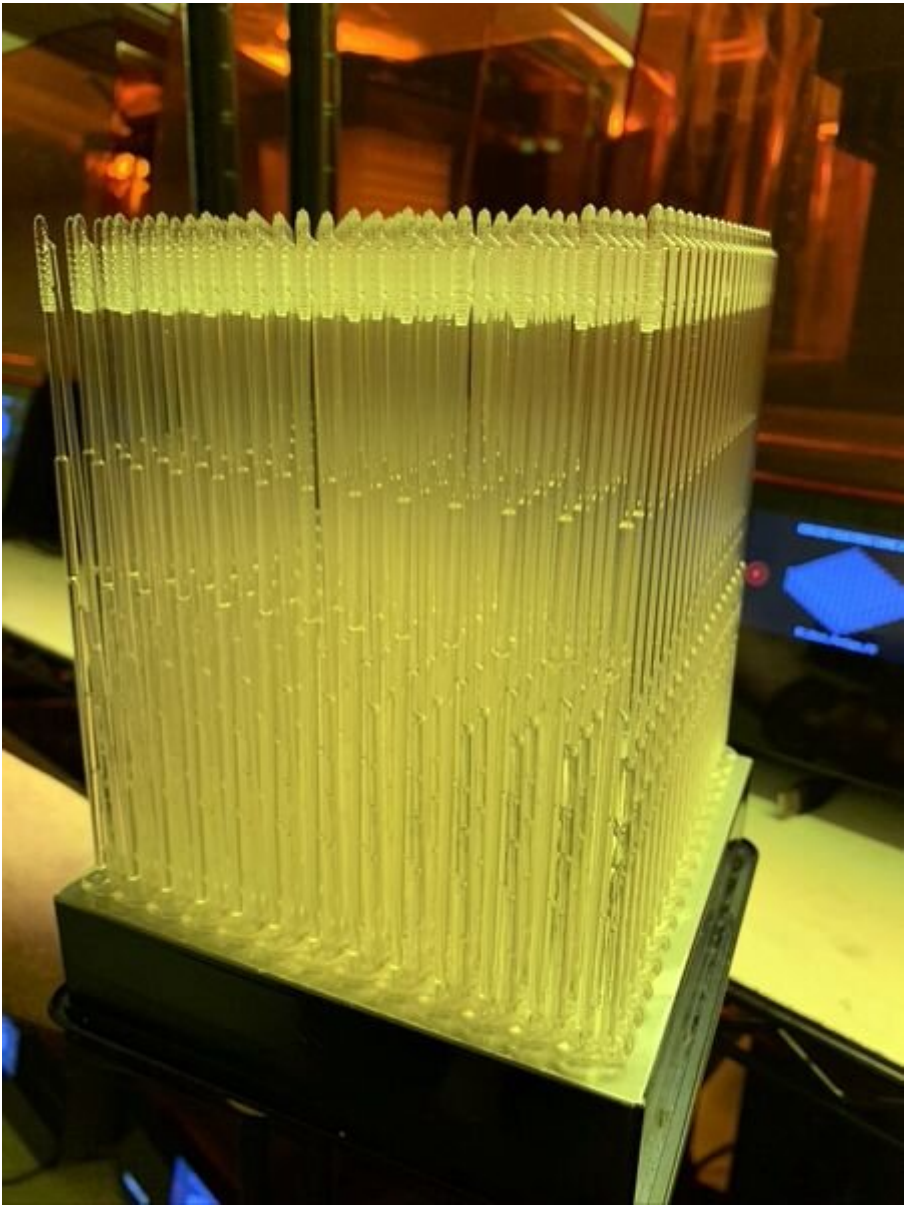


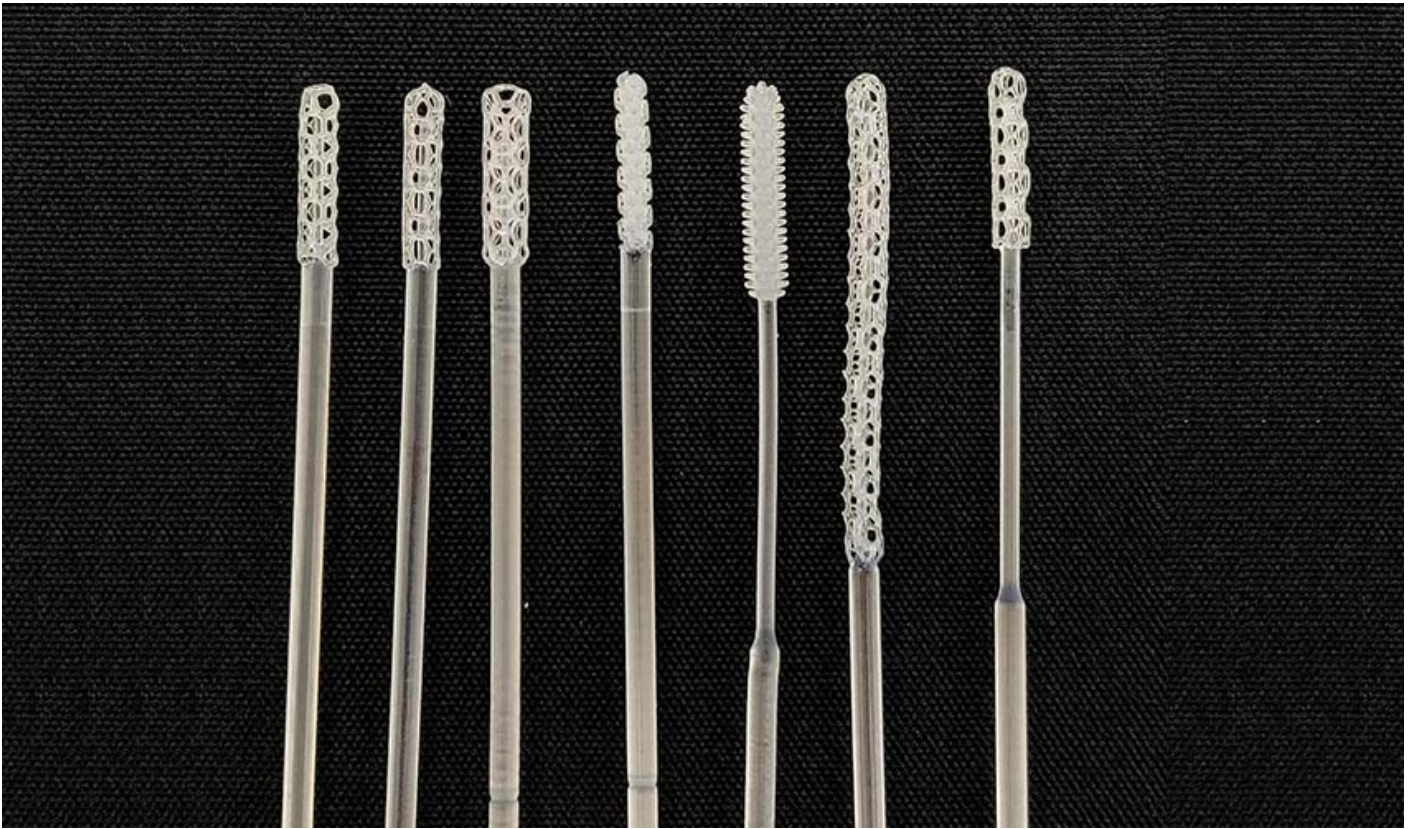

<https://www.marketwatch.com/story/my-3-d-printing-company-is-making-thousands-of-coronavirus-test-swabs-a-day-heres-how-we-did-it-2020-04-07>

<https://nypost.com/2020/03/30/nasal-swabs-are-being-3d-printed-amid-coronavirus-outbreak/>

Modèle 3D LABSud

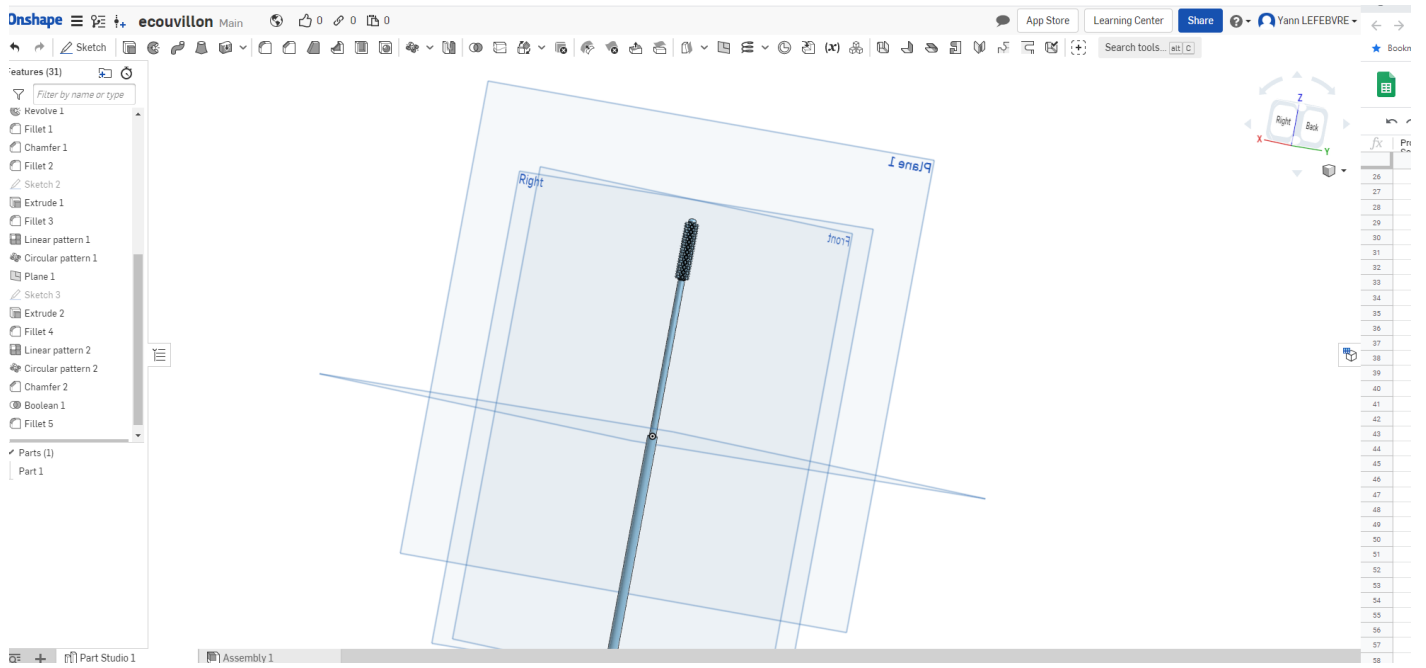

<https://cad.onshape.com/documents/e2c86f237e5786d655fe41d2/w/a126393b1aa555b749733322/e/a5eda9e8e0114a01b5b78678>

Ouvre porte sans contact

<https://www.materialise.com/en/hands-free-door-opener/technical-information>

Attache Masque

<https://www.thingiverse.com/thing:4232221>